
Pile Dynamics, Inc.

Transducer 265W

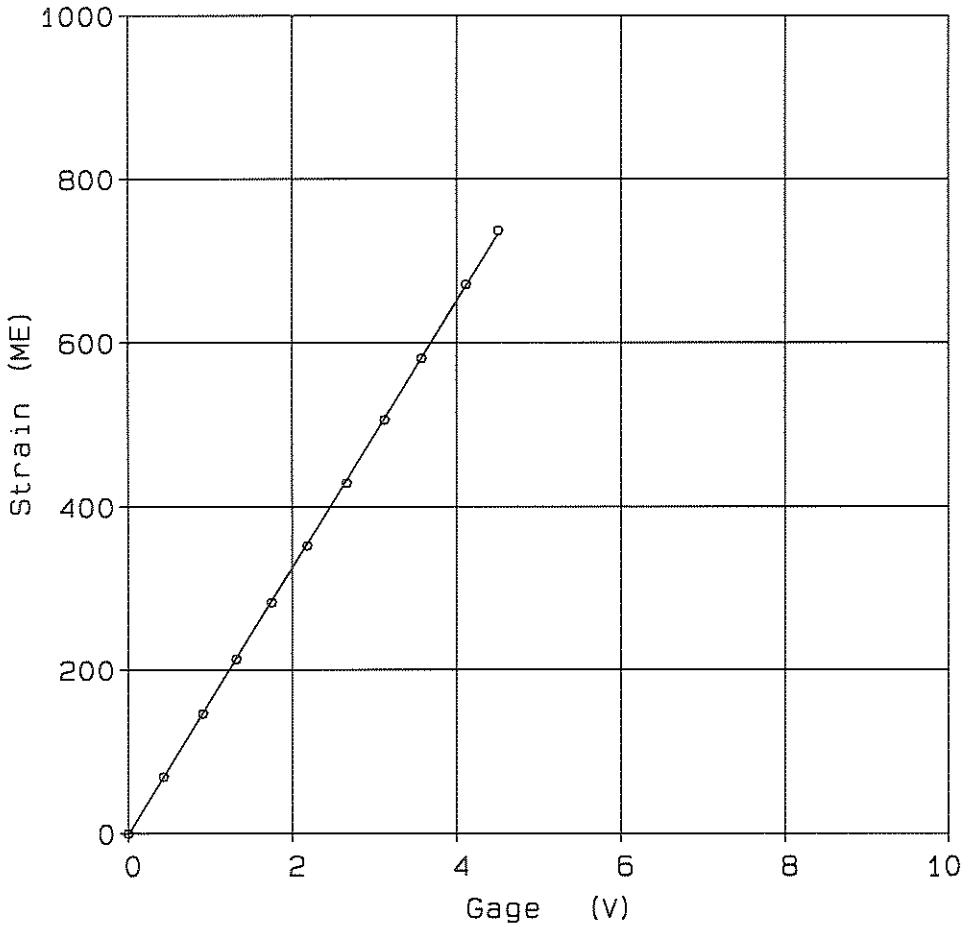

PDA Cal Factor = 163.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 567.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.44
146	.91
214	1.33
282	1.76
352	2.18
430	2.66
506	3.13
581	3.58
672	4.12
737	4.50

Calibrated by: Jim Sentchulyf

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2