Pile Dynamics Inc
Transducer 266I

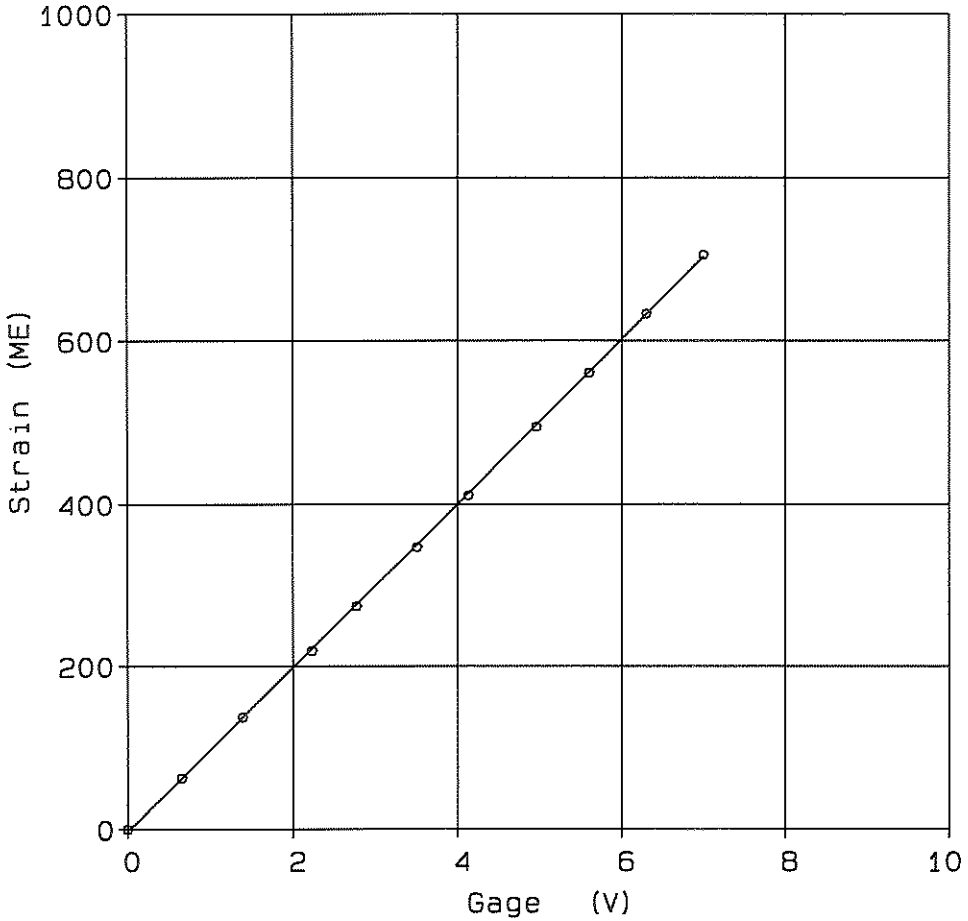

PDA Cal Factor = 100.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 350.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
64	.66
137	1.40
220	2.23
275	2.78
348	3.51
411	4.13
496	4.96
562	5.61
634	6.30
706	7.01

Calibrated by: _____

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2