Pile Dynamics, Inc.
Transducer 266W

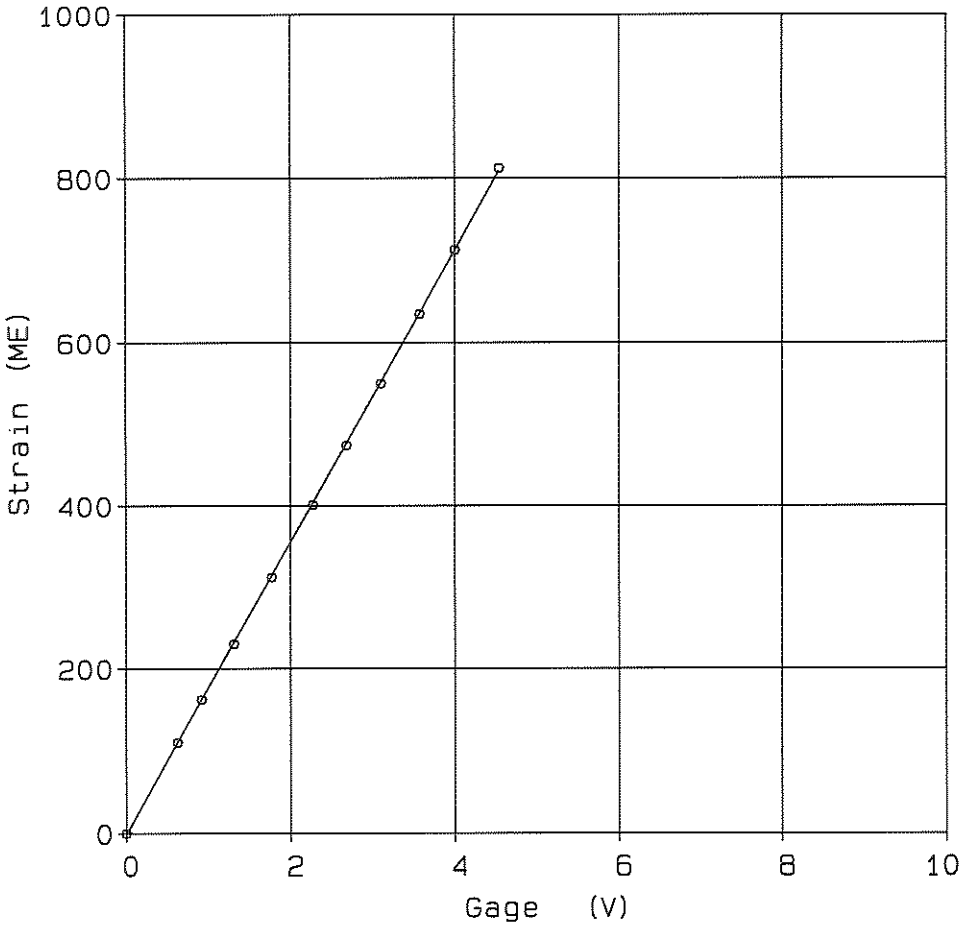

PDA Cal Factor = 178.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 620.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
110	.63
162	.93
230	1.31
312	1.77
401	2.28
475	2.68
550	3.10
636	3.58
714	4.01
812	4.55

Calibrated by: Jim Stentzelwolff

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2