Pile Dynamics Inc
Transducer 267I

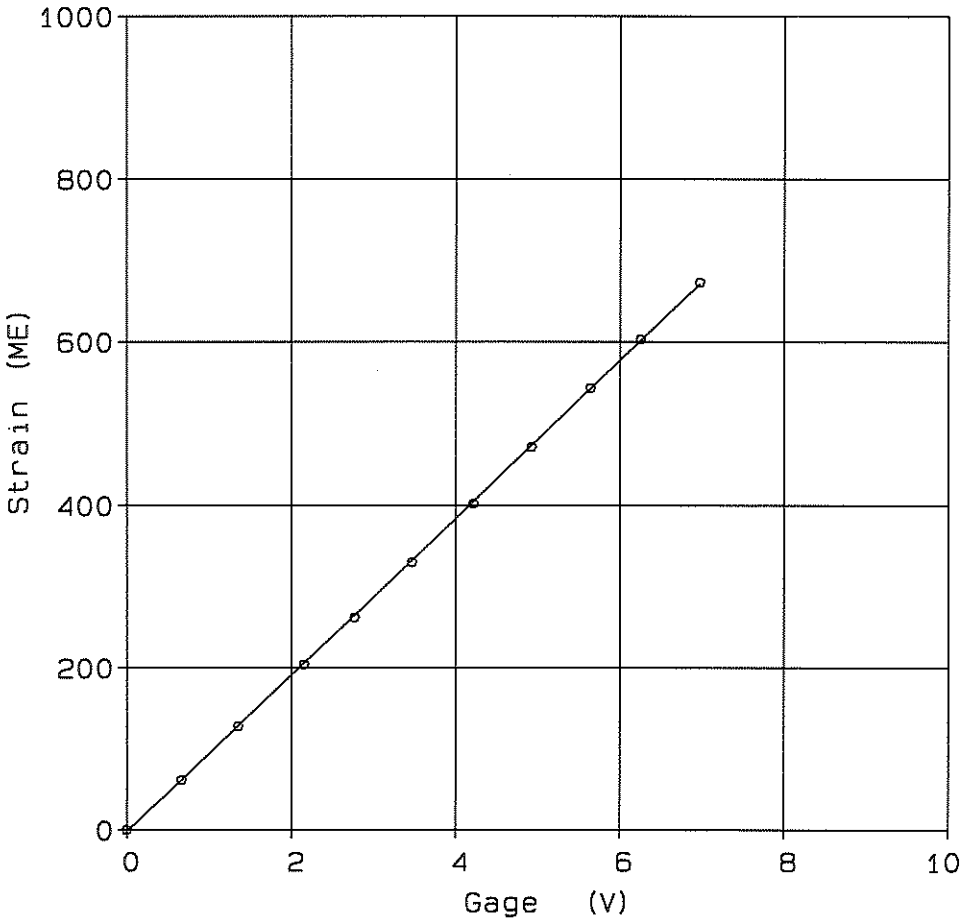

PDA Cal Factor = 96.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 335.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
63	.67
129	1.36
204	2.16
263	2.77
331	3.46
403	4.21
471	4.92
543	5.65
603	6.26
674	6.98

Calibrated by: _____

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2