
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 267W

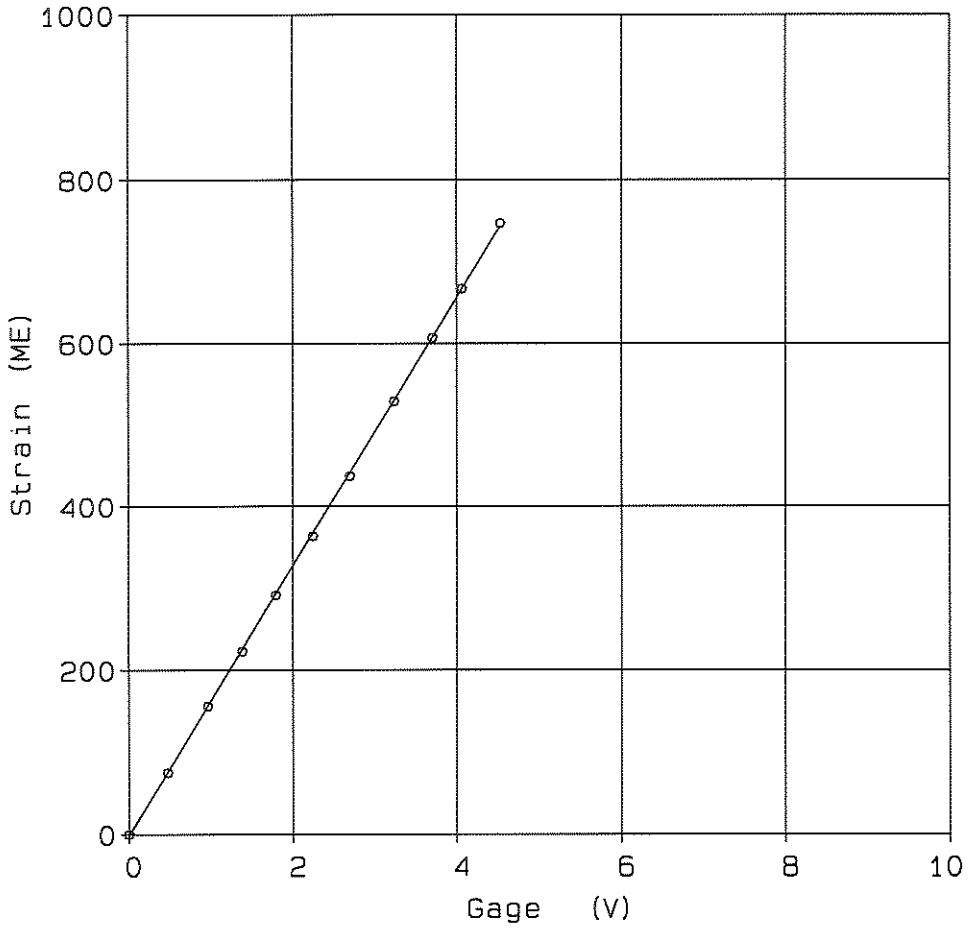

PDA Cal Factor = 164.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 571.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.47
156	.97
223	1.38
292	1.80
363	2.24
437	2.69
529	3.24
608	3.70
668	4.07
747	4.54

Calibrated by: Jim Scarbrough

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2