Pile Dynamics Inc
Transducer 268I

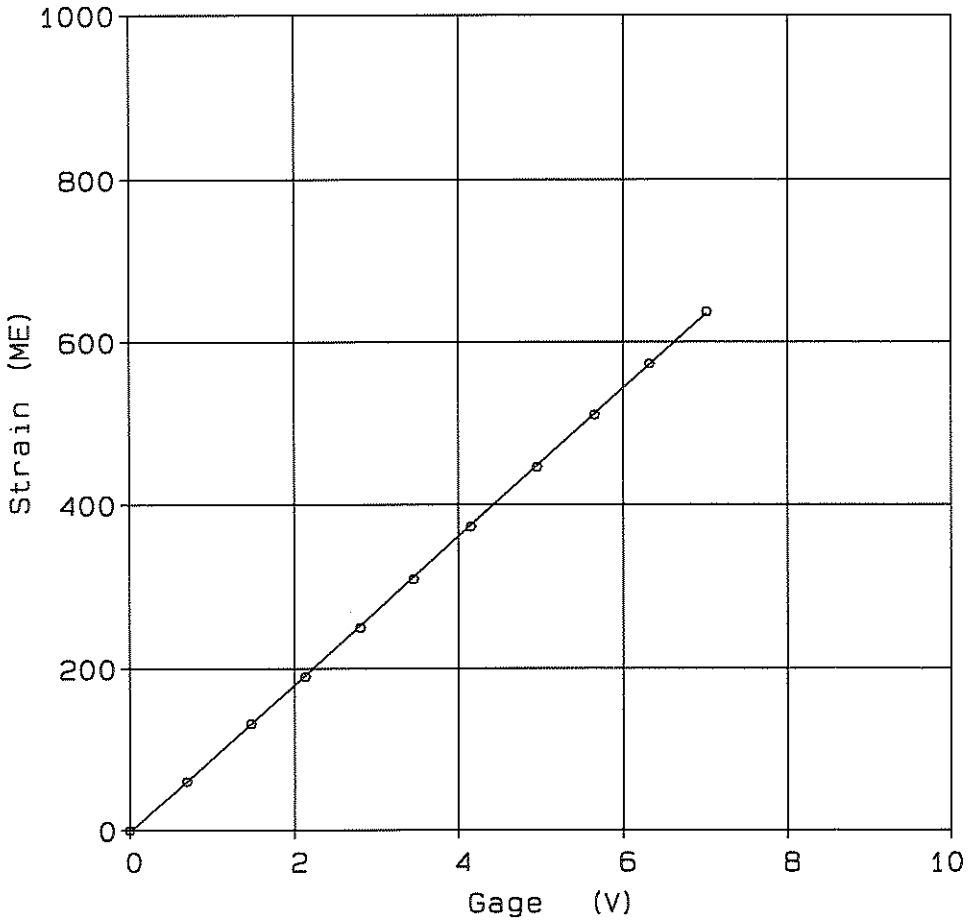

PDA Cal Factor = 90.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 315.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
61	.69
132	1.48
190	2.13
251	2.81
310	3.45
374	4.16
446	4.95
511	5.65
574	6.33
637	7.02

Calibrated by: _____

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2