Pile Dynamics, Inc.
Transducer 268W

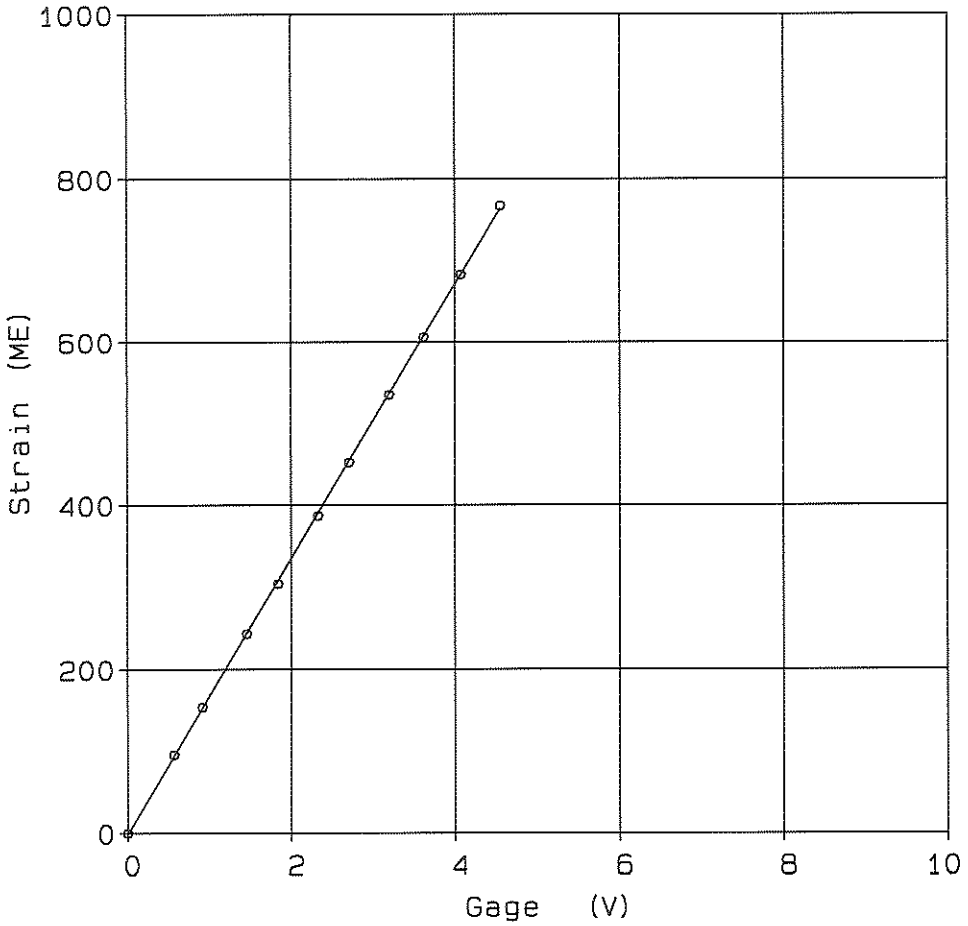

PDA Cal Factor = 168.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 583.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
96	.57
154	.92
243	1.46
305	1.84
388	2.33
452	2.71
535	3.21
607	3.62
683	4.07
767	4.56

Calibrated by: Jim Deutschdorff

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2