Pile Dynamics Inc
Transducer 269I

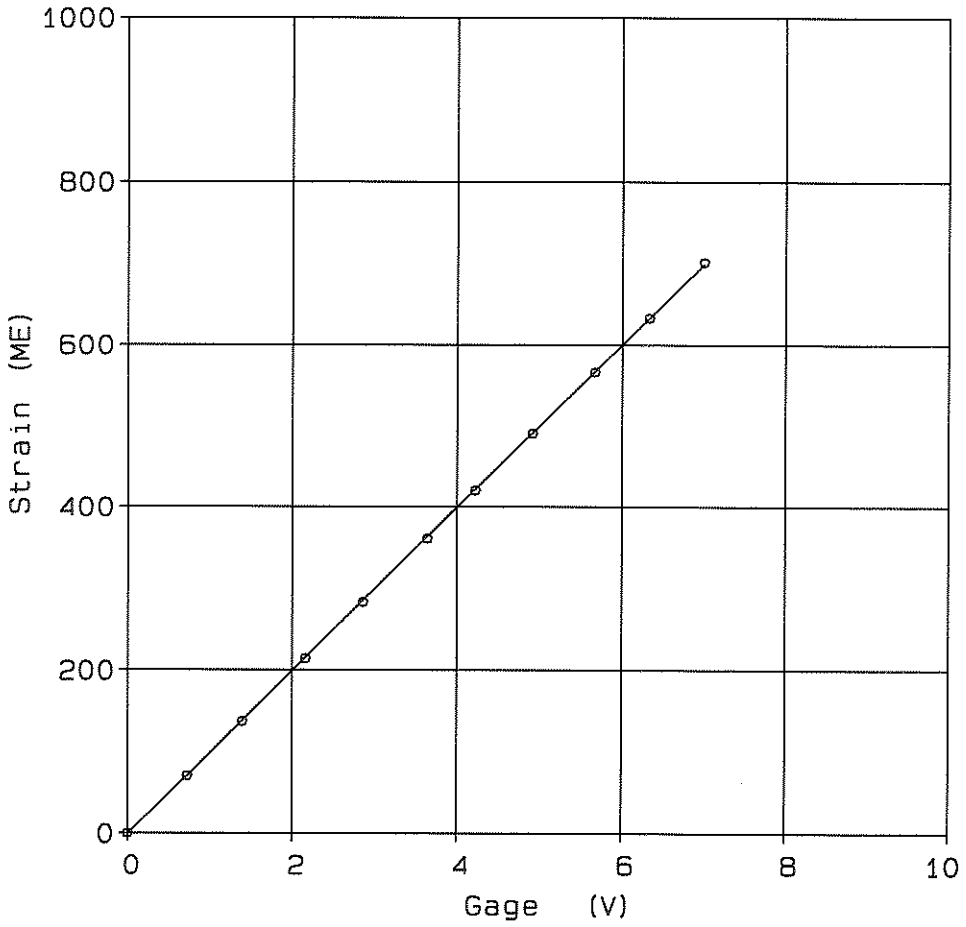

PDA Cal Factor	=	100.2 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	347.9 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
71	.72
138	1.39
214	2.17
284	2.86
362	3.64
420	4.23
490	4.92
567	5.68
634	6.33
702	7.01

Calibrated by: _____

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2