
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 270W

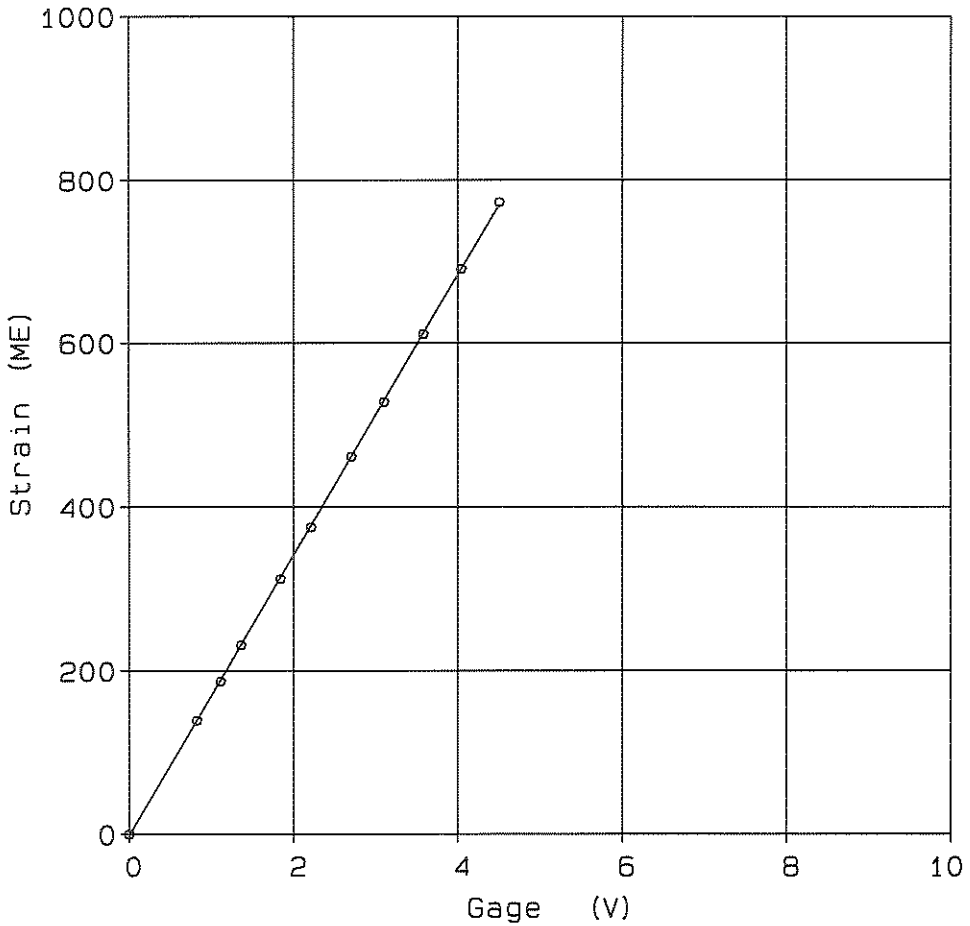

PDA Cal Factor = 171.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 595.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
140	.82
188	1.11
231	1.37
313	1.84
376	2.22
461	2.71
529	3.10
612	3.58
691	4.05
774	4.51

Calibrated by: Jim Stuthcliff

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2