Pile Dynamics Inc
Transducer 271I

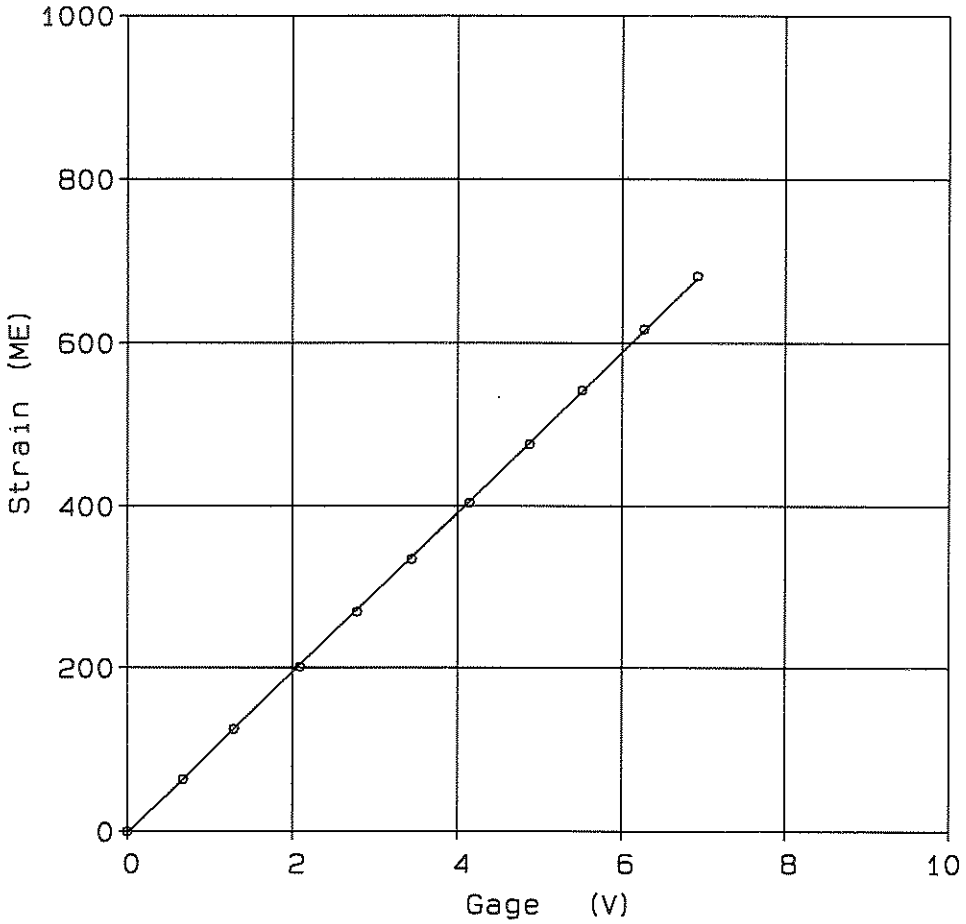

PDA Cal Factor = 98.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 342.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
64	.67
125	1.30
202	2.09
270	2.79
335	3.44
405	4.15
477	4.87
542	5.52
617	6.28
682	6.92

Calibrated by: _____

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2