Pile Dynamics Inc
Transducer 272I

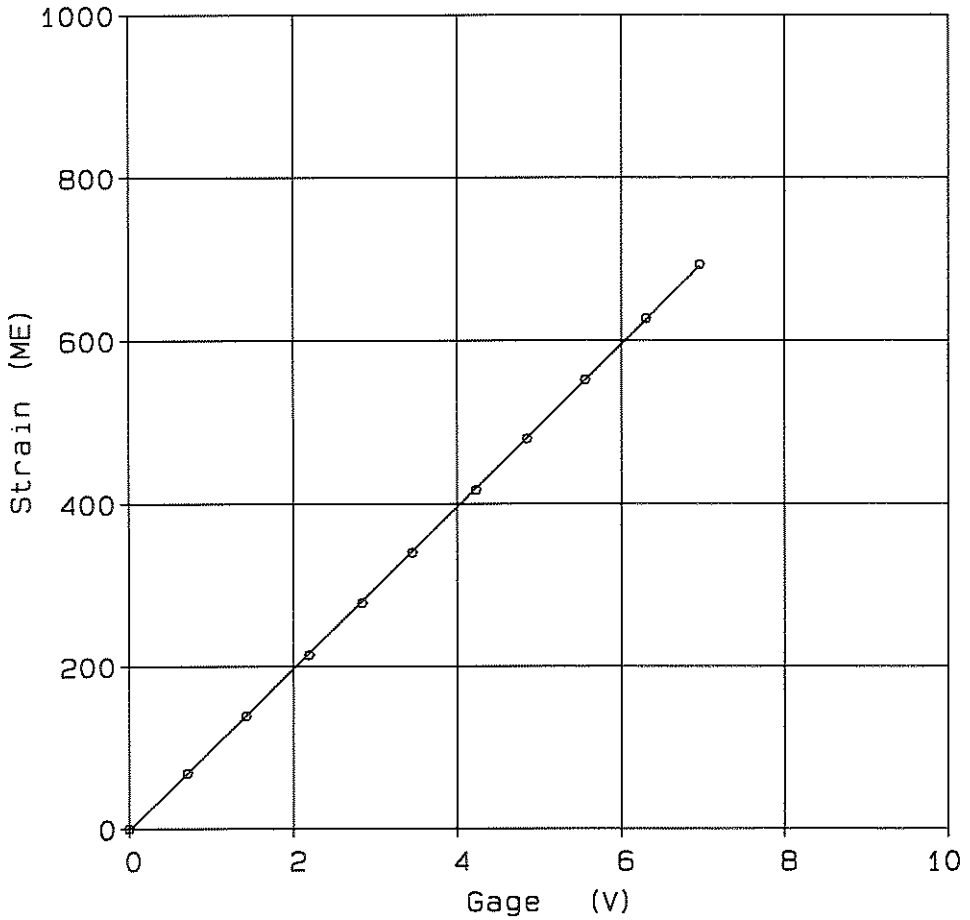

PDA Cal Factor = 99.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 346.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.72
139	1.43
214	2.19
279	2.84
340	3.46
418	4.23
480	4.85
552	5.57
627	6.31
693	6.96

Calibrated by: James M Bork

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2