
Pile Dynamics, Inc.

Transducer 272W

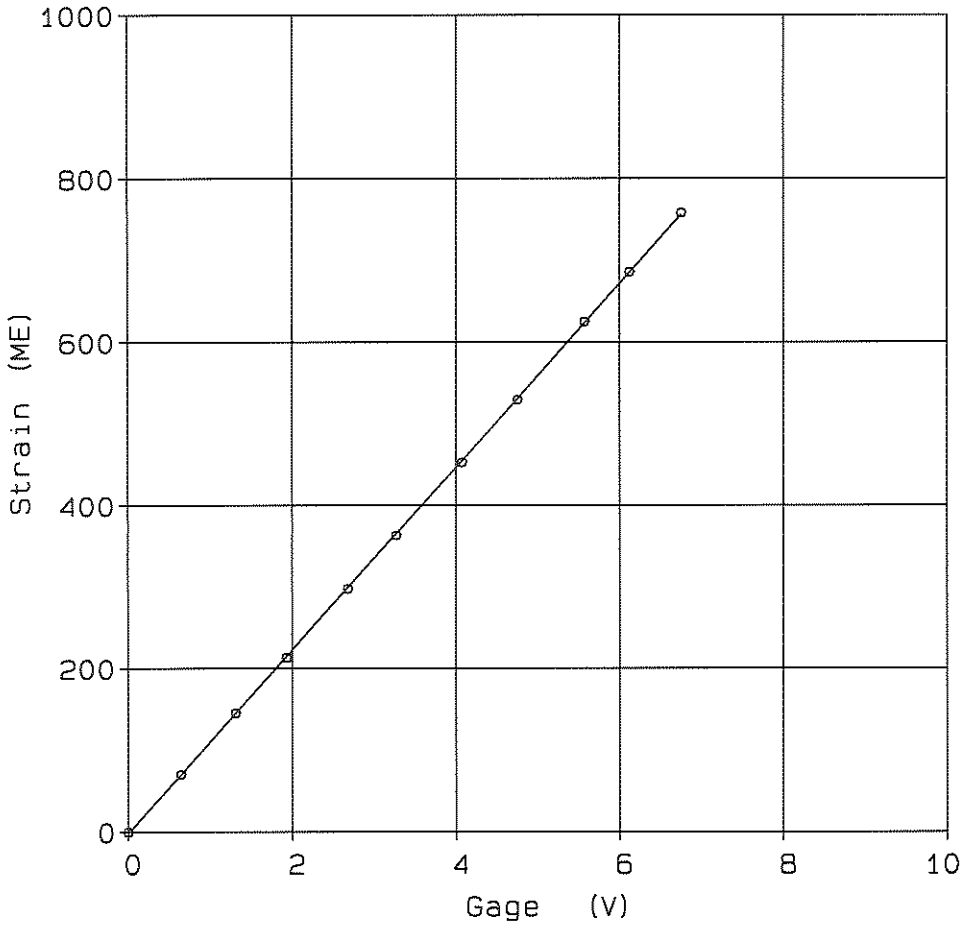

PDA Cal Factor = 112.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 390.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.65
145	1.31
214	1.94
298	2.68
363	3.28
454	4.07
531	4.75
626	5.58
687	6.13
758	6.76

Calibrated by: Jim Swanstrom

Calibrated on: 13-May-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2