Pile Dynamics Inc
Transducer 273I

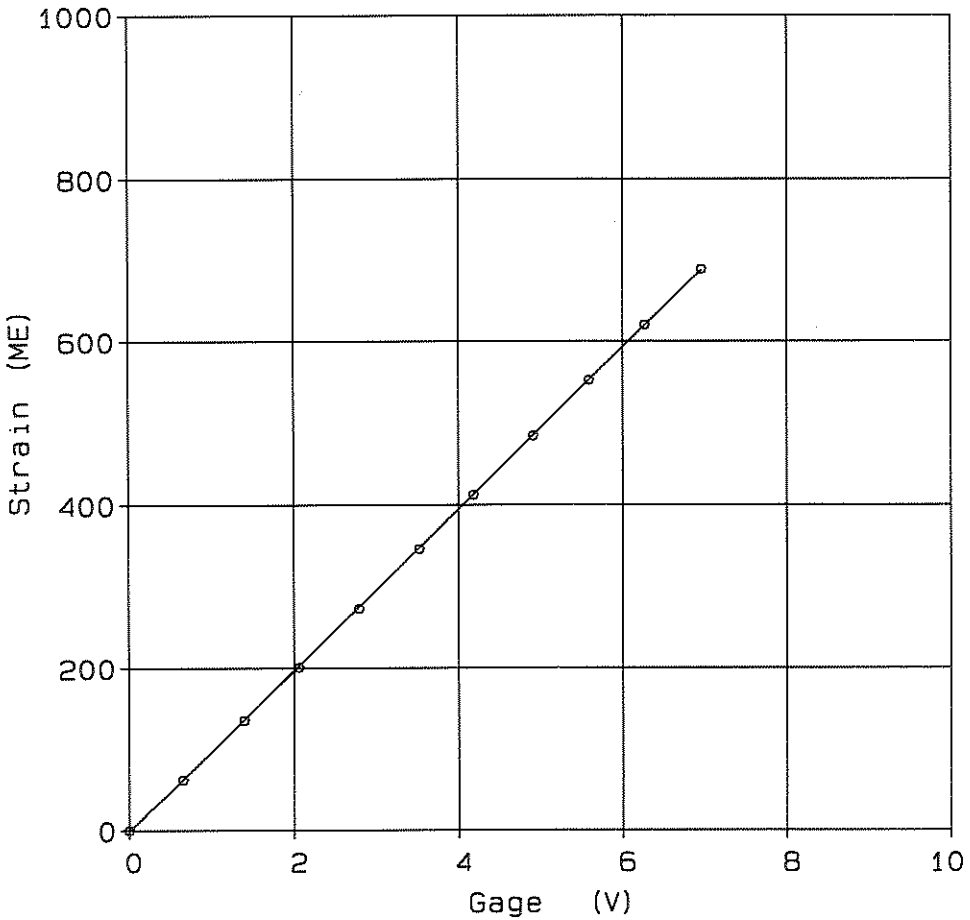

PDA Cal Factor = 99.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 344.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
64	.66
137	1.40
202	2.07
274	2.79
347	3.53
412	4.19
484	4.91
552	5.59
620	6.27
690	6.96

Calibrated by: _____

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2