Pile Dynamics, Inc.
Transducer 273W

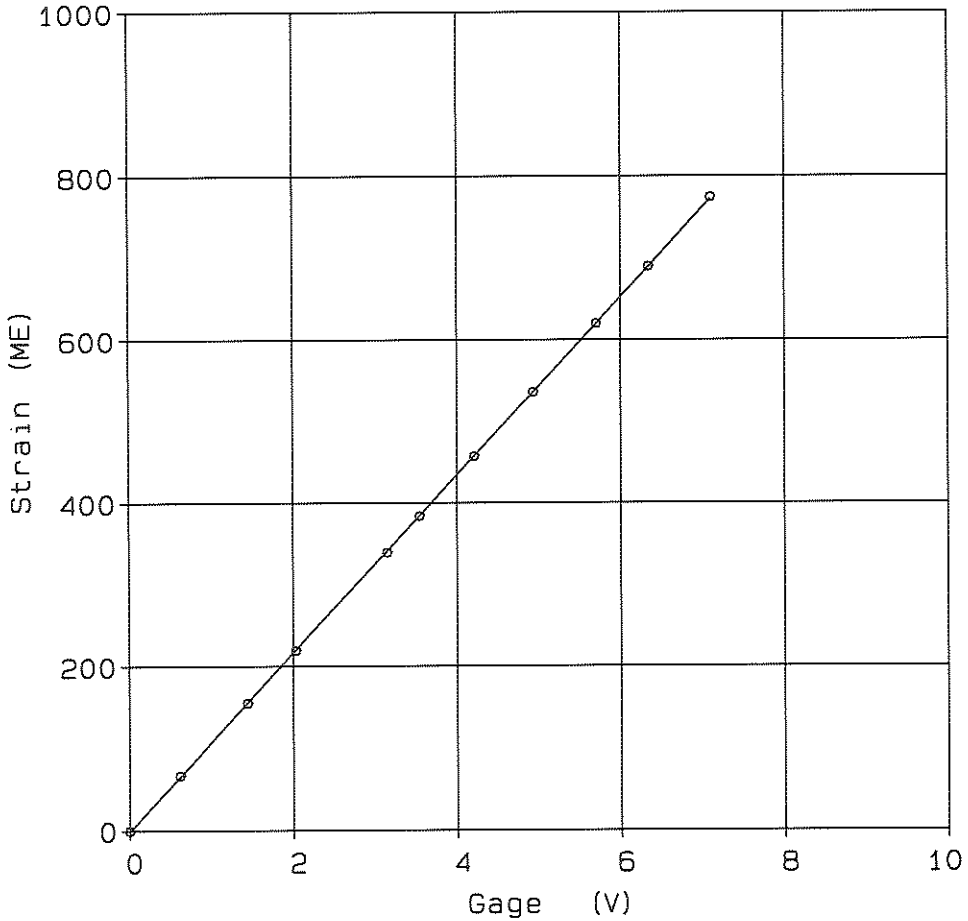

PDA Cal Factor	=	109.0 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	378.6 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.62
156	1.44
220	2.04
339	3.14
384	3.55
457	4.21
537	4.94
621	5.70
691	6.35
774	7.10

Calibrated by: Jim Rausche

Calibrated on: 13-May-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2