Pile Dynamics Inc
Transducer 274I

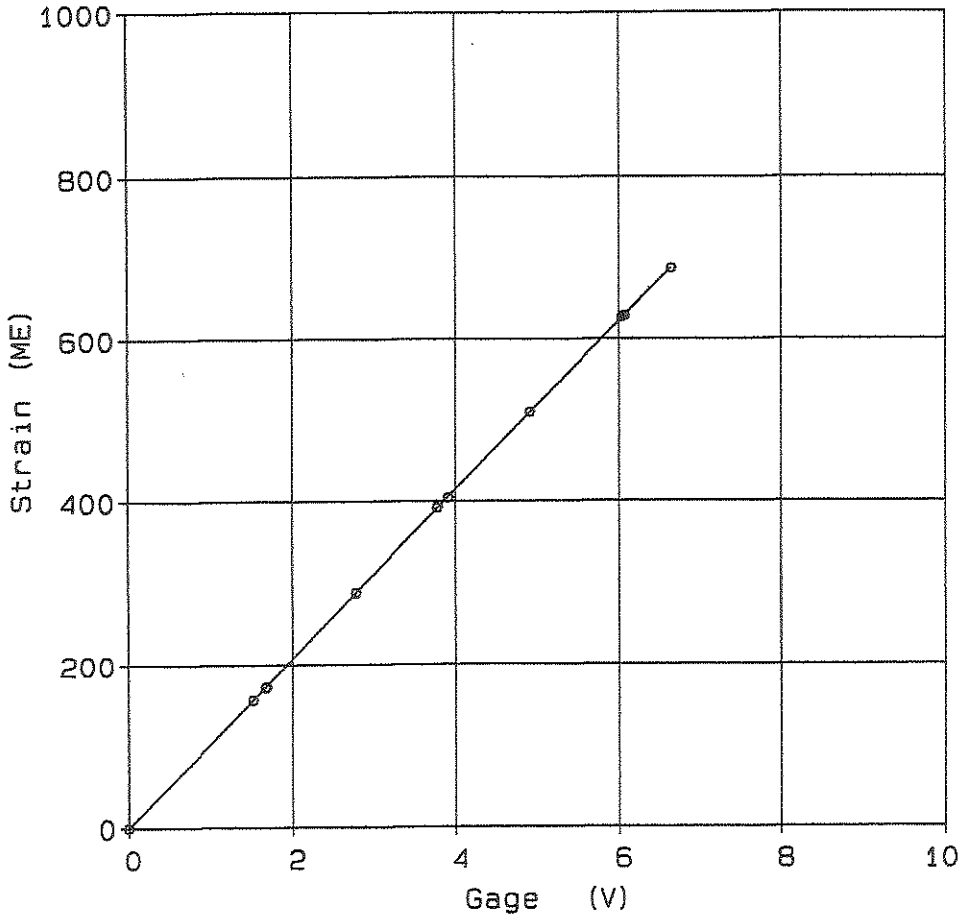

PDA Cal Factor = 103.7 ME/V
Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Factor = 360.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
158	1.53
173	1.68
173	1.69
289	2.79
393	3.78
405	3.91
510	4.91
626	6.04
628	6.08
687	6.65

Calibrated by: J Warndorff

Calibrated on: 25-Oct-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2