Pile Dynamics, Inc.
Transducer 274W

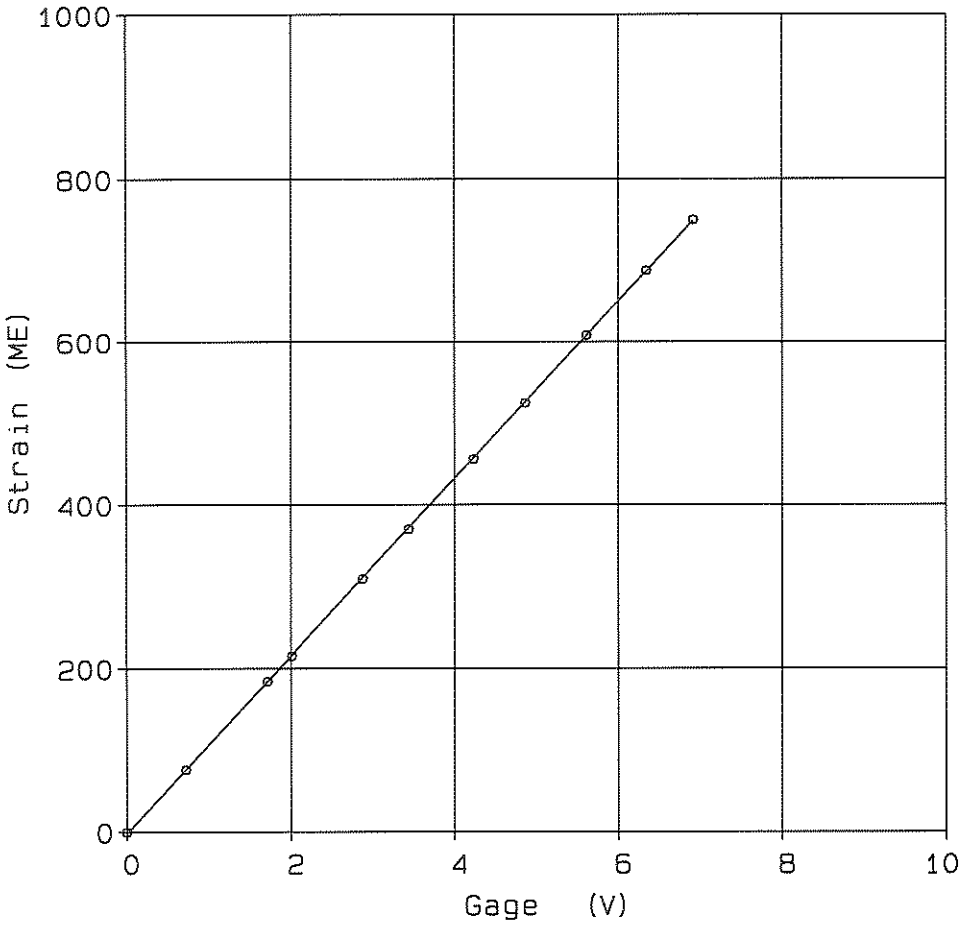

PDA Cal Factor = 108.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 377.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
77	.73
184	1.71
216	2.02
310	2.88
370	3.44
457	4.23
525	4.87
609	5.62
688	6.34
751	6.92

Calibrated by: Jim Dewberry

Calibrated on: 13-May-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2