Pile Dynamics Inc
Transducer 275I

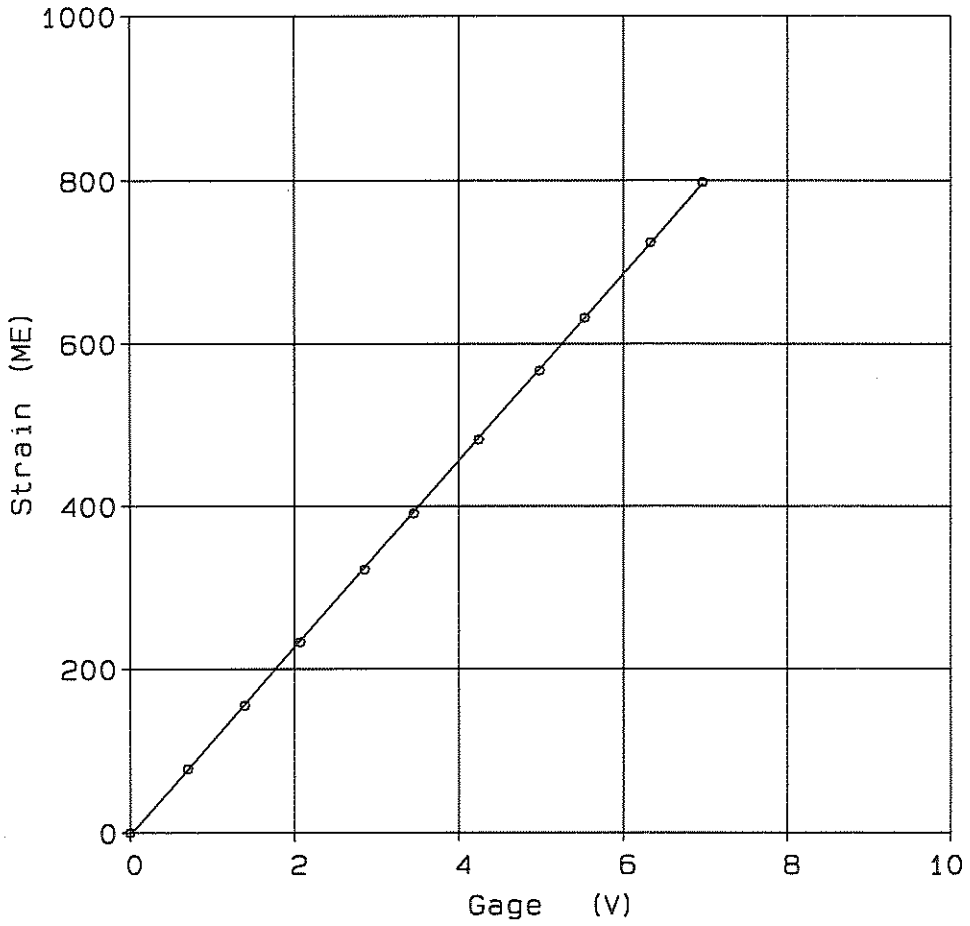

PDA Cal Factor = 114.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 398.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
80	.71
157	1.40
233	2.08
323	2.85
392	3.46
483	4.25
568	4.99
632	5.53
725	6.33
799	6.97

Calibrated by: _____

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2