Pile Dynamics, Inc.
Transducer 275W

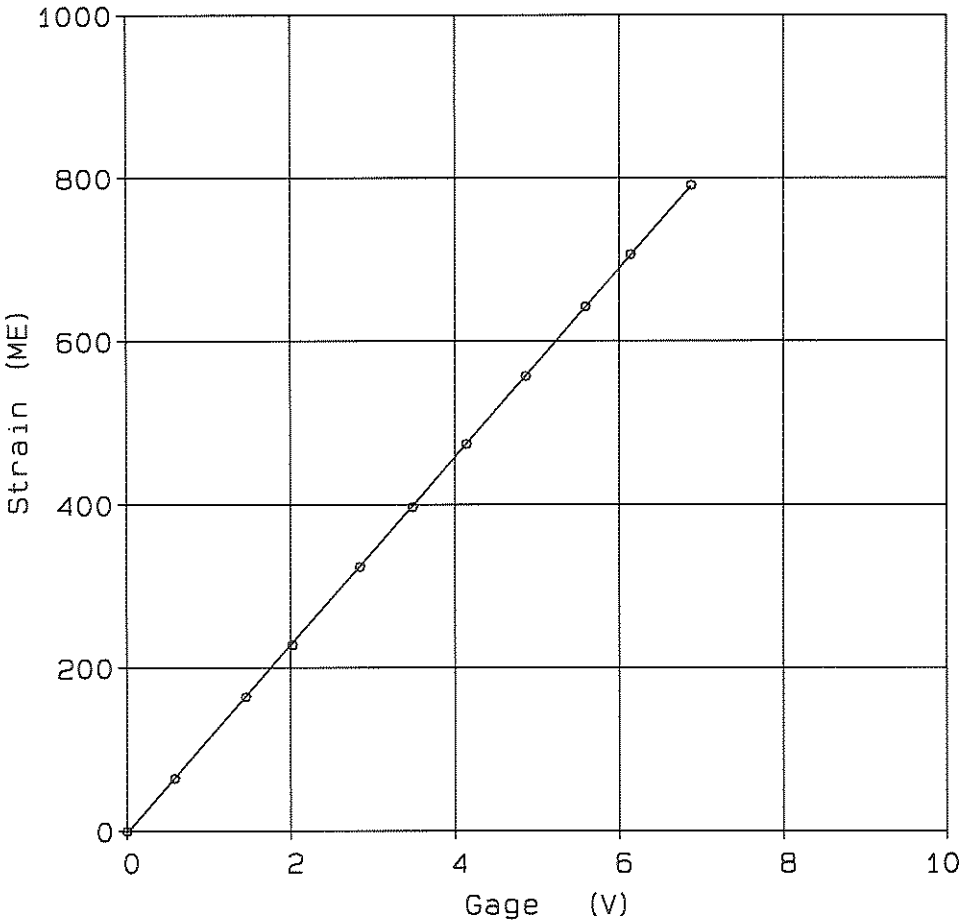

PDA Cal Factor = 115.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 400.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
64	.58
165	1.45
228	2.02
324	2.85
397	3.48
474	4.14
558	4.86
642	5.59
706	6.15
791	6.88

Calibrated by: Jim Stratobeff

Calibrated on: 13-May-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2