Pile Dynamics Inc
Transducer 276I

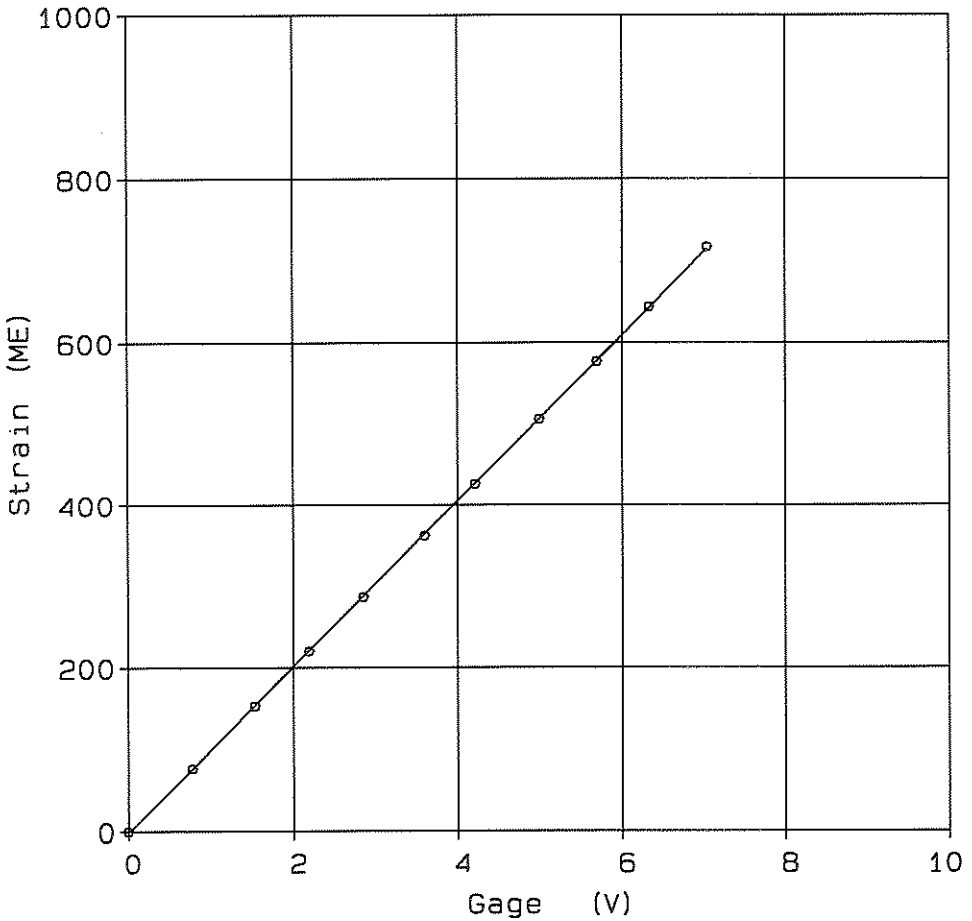

PDA Cal Factor = 101.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 353.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
77	.78
154	1.53
221	2.20
287	2.85
363	3.60
426	4.21
506	5.00
578	5.69
644	6.34
718	7.05

Calibrated by:

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2