Pile Dynamics Inc

Transducer 276W

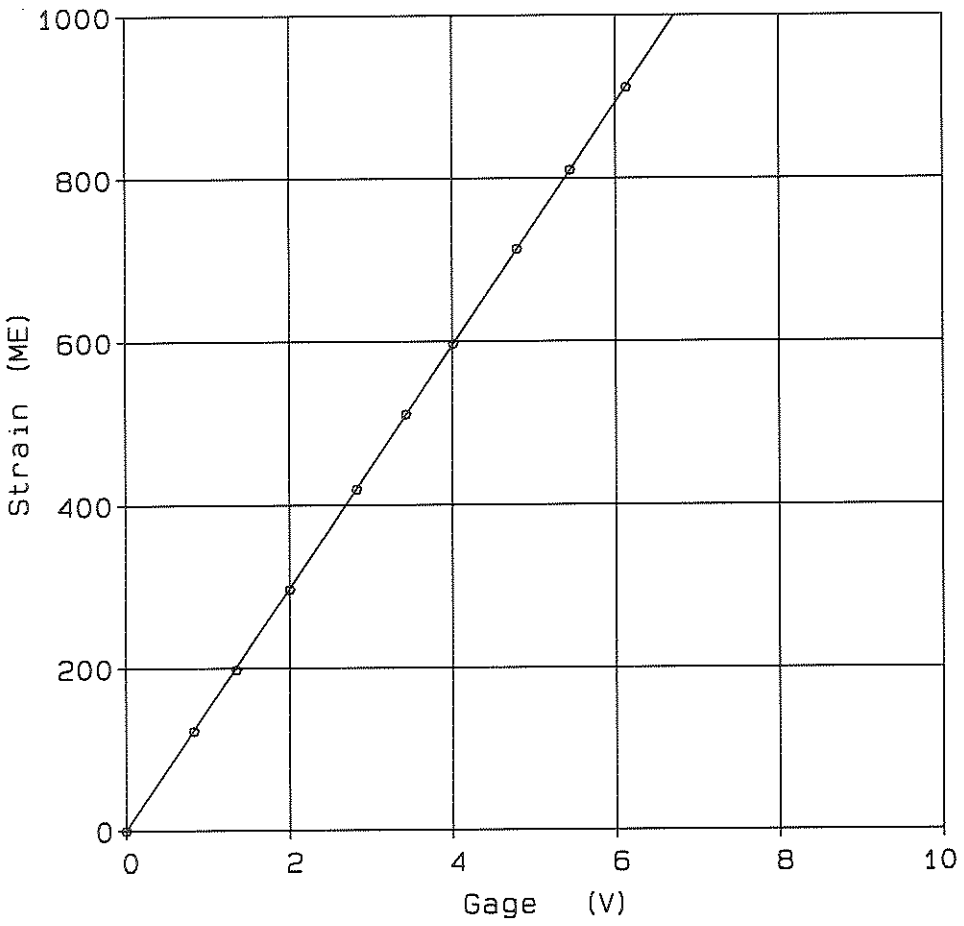

PDA Cal Factor = 148.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 516.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
123	.83
199	1.35
297	2.00
420	2.82
512	3.44
598	4.02
713	4.79
810	5.45
912	6.14
1055	7.10

Calibrated by: _____

Calibrated on: 15-Apr-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2