Pile Dynamics Inc
Transducer 277W

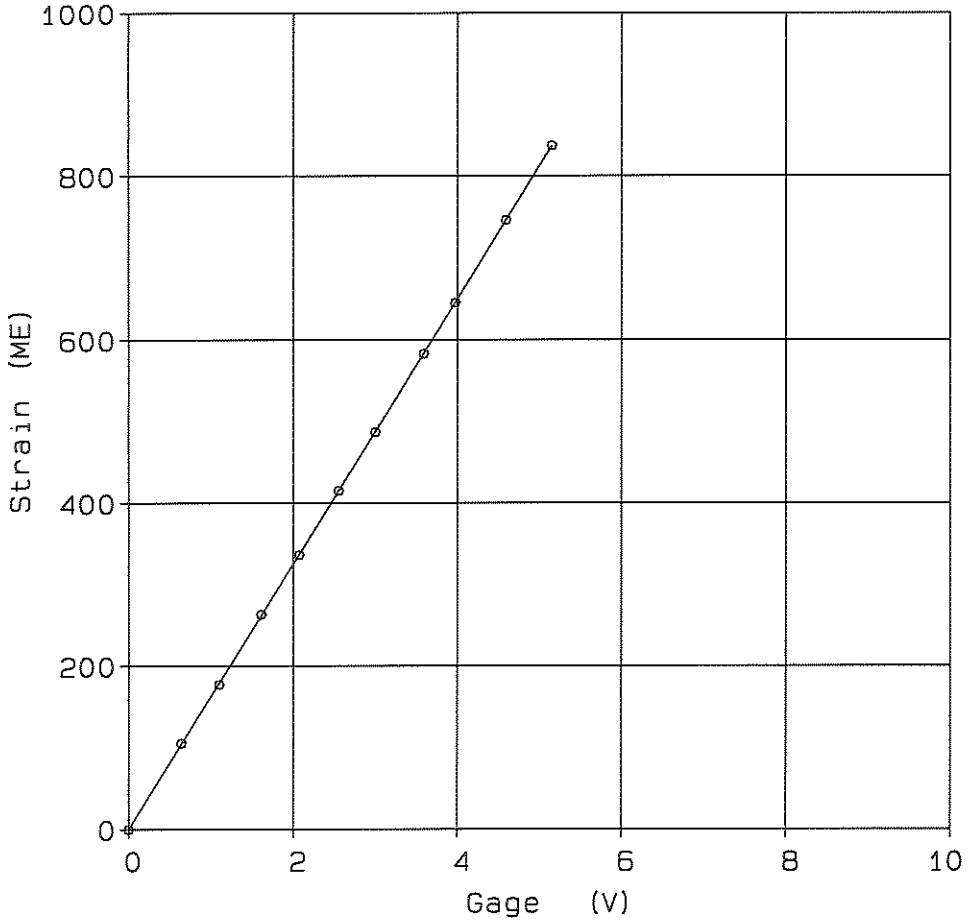

PDA Cal Factor = 162.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 564.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
105	.65
178	1.10
263	1.62
336	2.07
415	2.56
488	3.01
584	3.60
645	3.98
747	4.60
837	5.16

Calibrated by: _____

Calibrated on: 11-Apr-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2