Pile Dynamics Inc
Transducer 278I

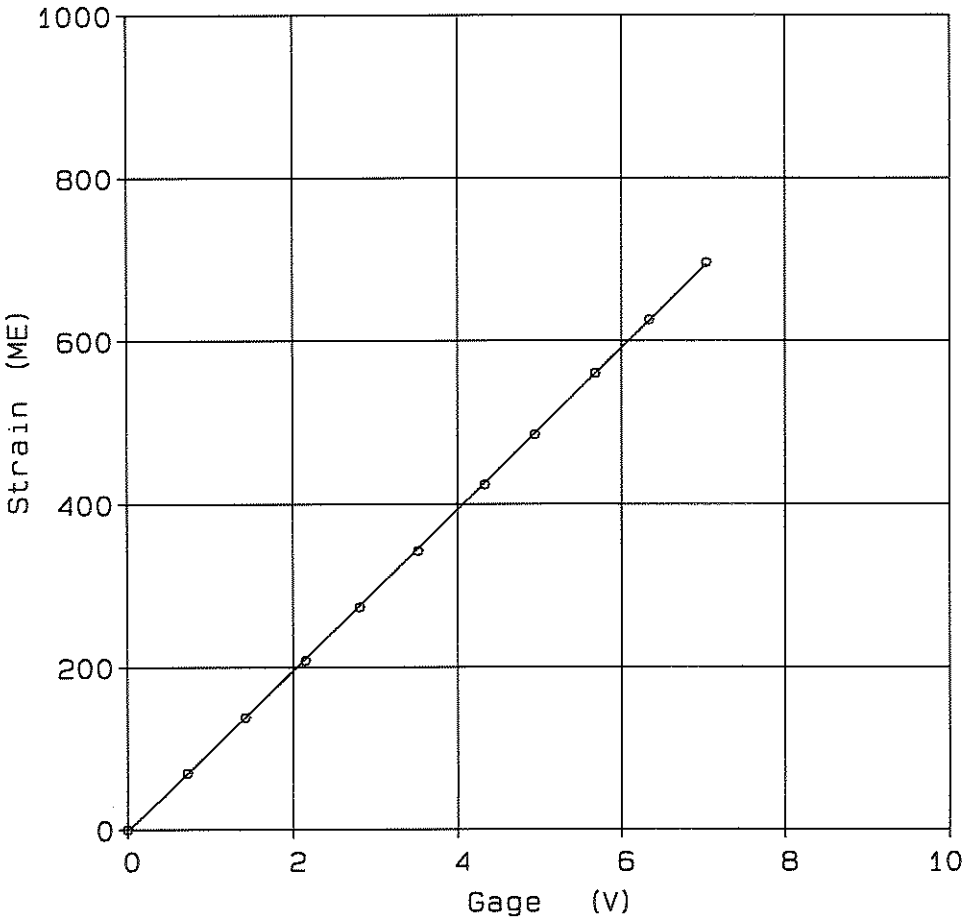

PDA Cal Factor = 99.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 343.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.73
139	1.43
209	2.15
275	2.82
344	3.52
425	4.33
486	4.94
561	5.69
627	6.35
697	7.05

Calibrated by: _____

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2