Pile Dynamics, Inc.

Transducer 278W

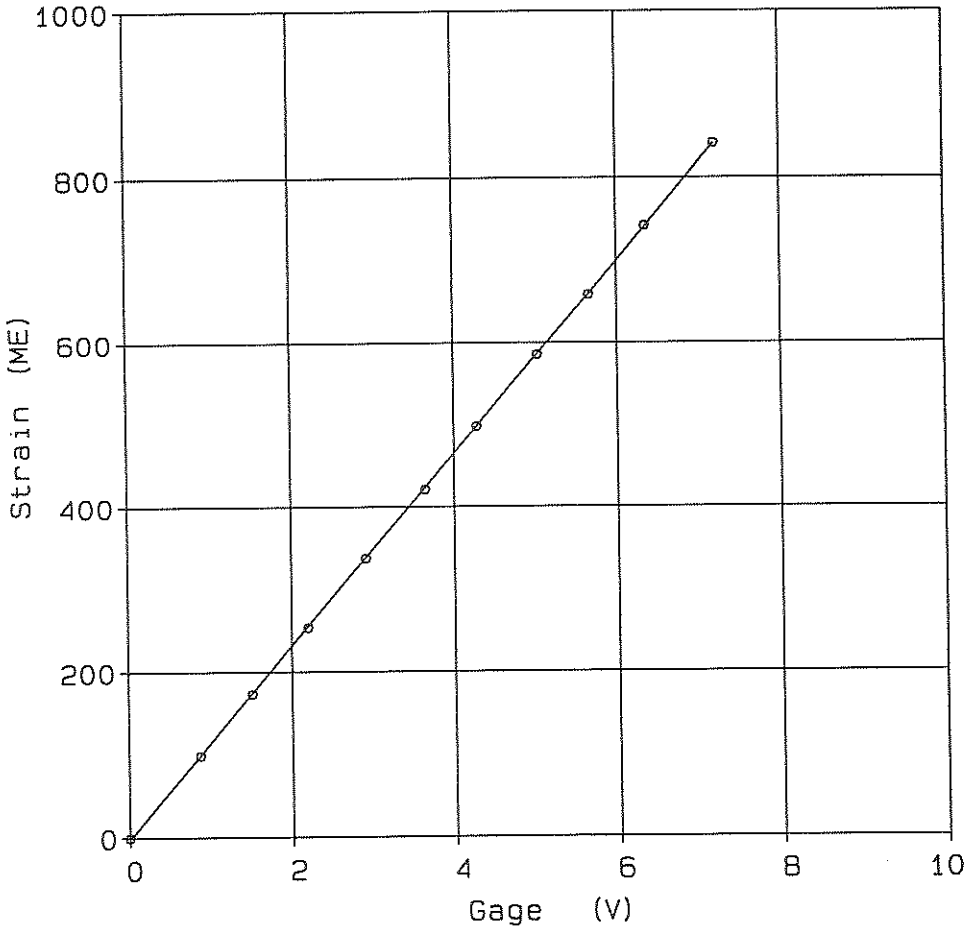

PDA Cal Factor = 116.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 405.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
99	.87
174	1.51
253	2.20
337	2.92
421	3.64
498	4.29
586	5.03
660	5.67
742	6.36
842	7.22

Calibrated by: J. S. Rawtechoff

Calibrated on: 12-Jan-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2