Pile Dynamics Inc
Transducer 279I

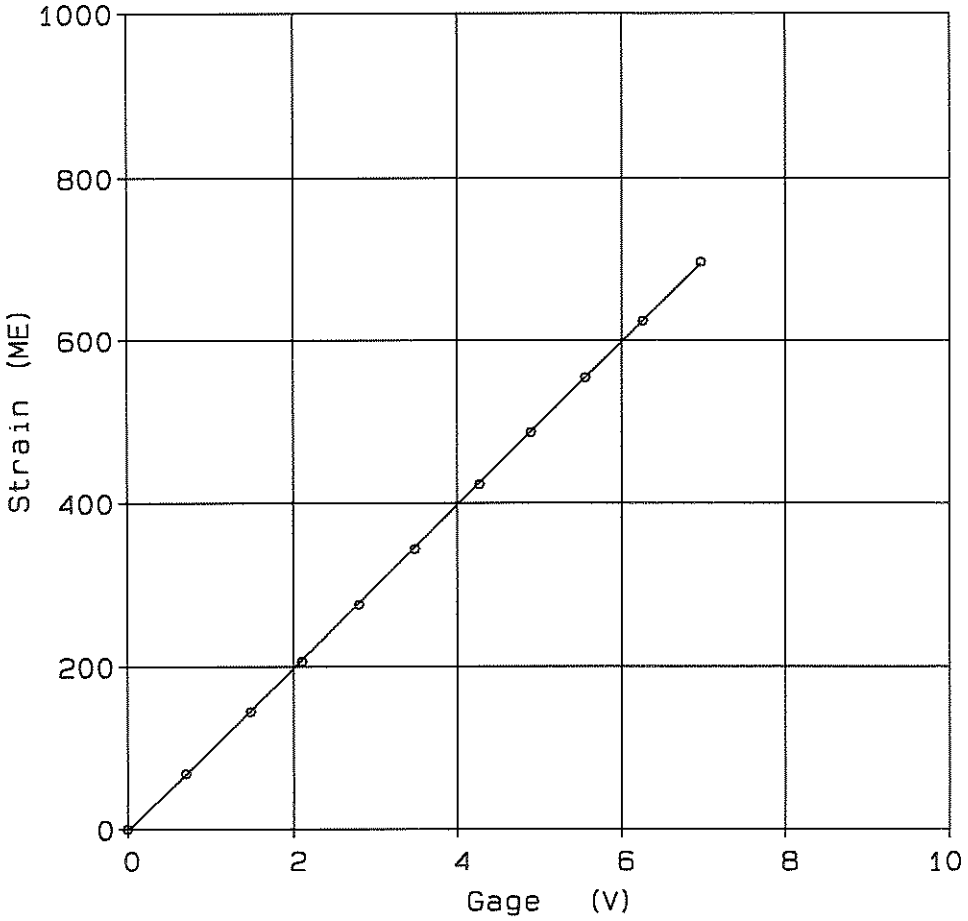

PDA Cal Factor = 100.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 347.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.71
145	1.48
207	2.10
277	2.80
345	3.49
424	4.28
488	4.90
554	5.57
625	6.26
698	6.98

Calibrated by: _____

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2