Pile Dynamics, Inc.
Transducer 279W

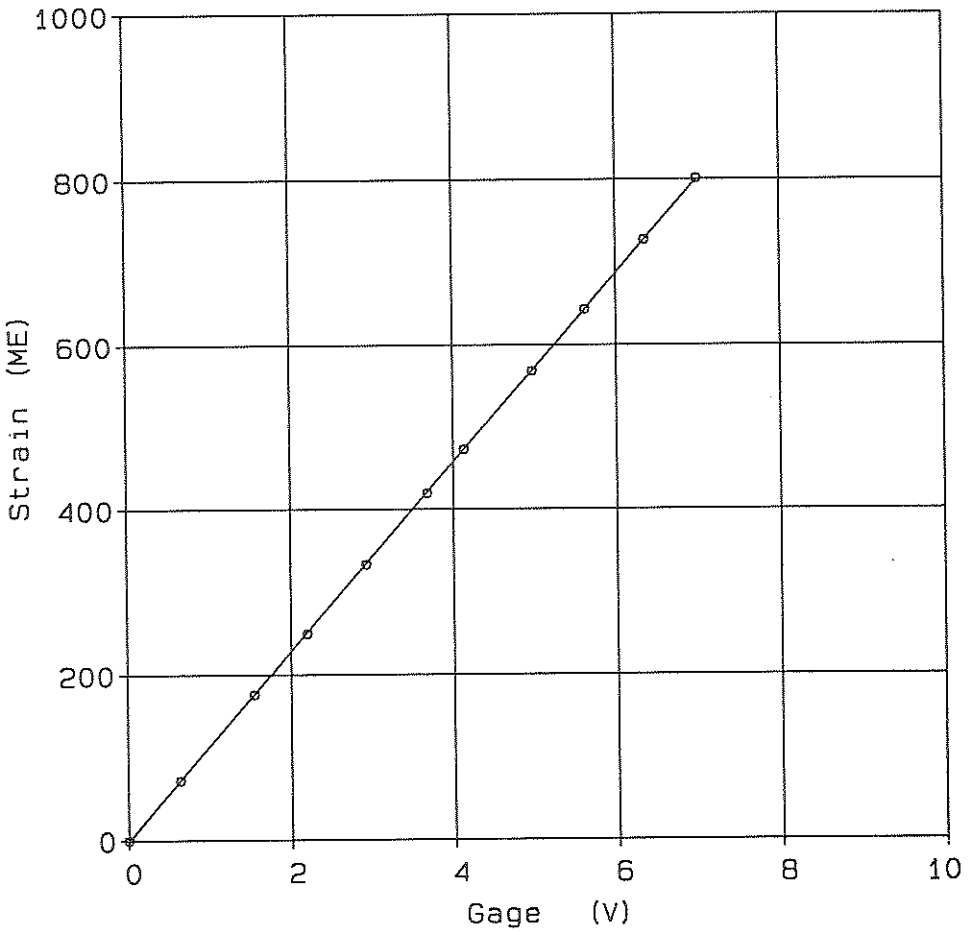

PDA Cal Factor = 114.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 398.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
72	.65
176	1.56
249	2.20
333	2.93
420	3.69
472	4.14
568	4.97
644	5.62
728	6.35
801	6.99

Calibrated by: J. S. Rubeteff

Calibrated on: 12-Jan-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2