Pile Dynamics, Inc.

Transducer 280W

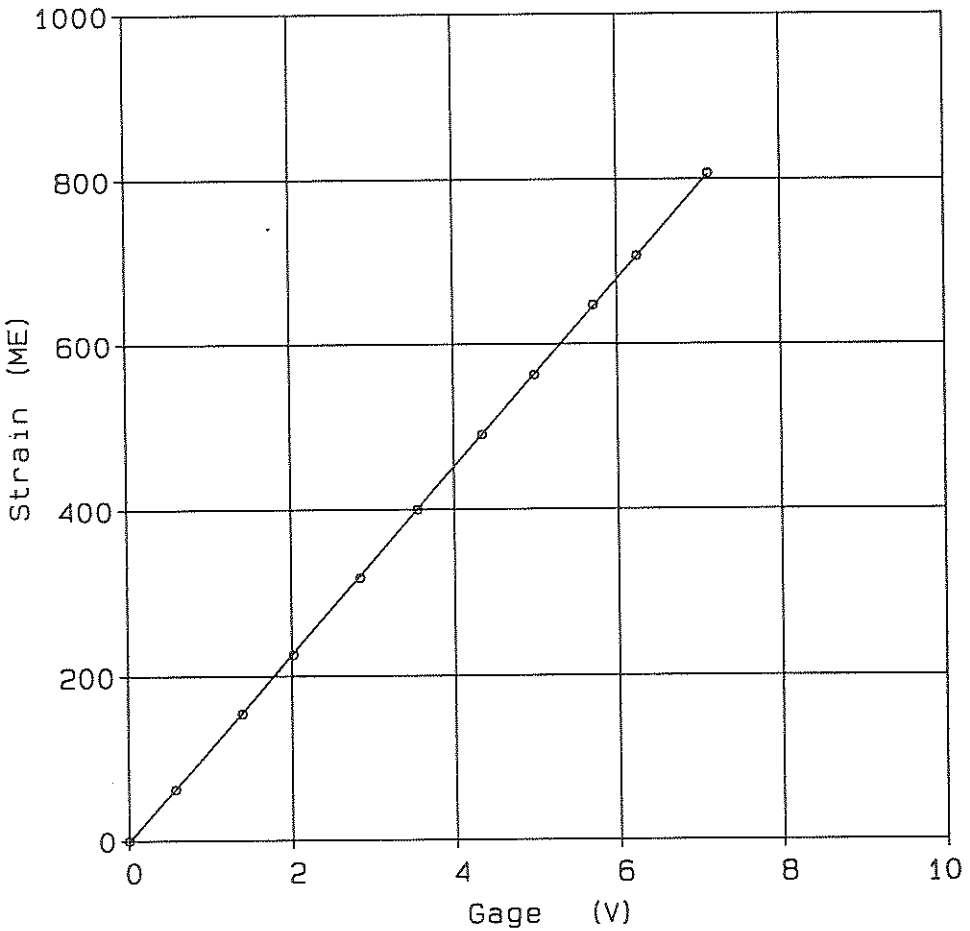

PDA Cal Factor = 113.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 393.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
64	.58
156	1.39
226	2.02
318	2.84
400	3.56
492	4.36
563	4.99
647	5.72
707	6.25
808	7.14

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 12-Jan-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2