Pile Dynamics Inc
Transducer 281I

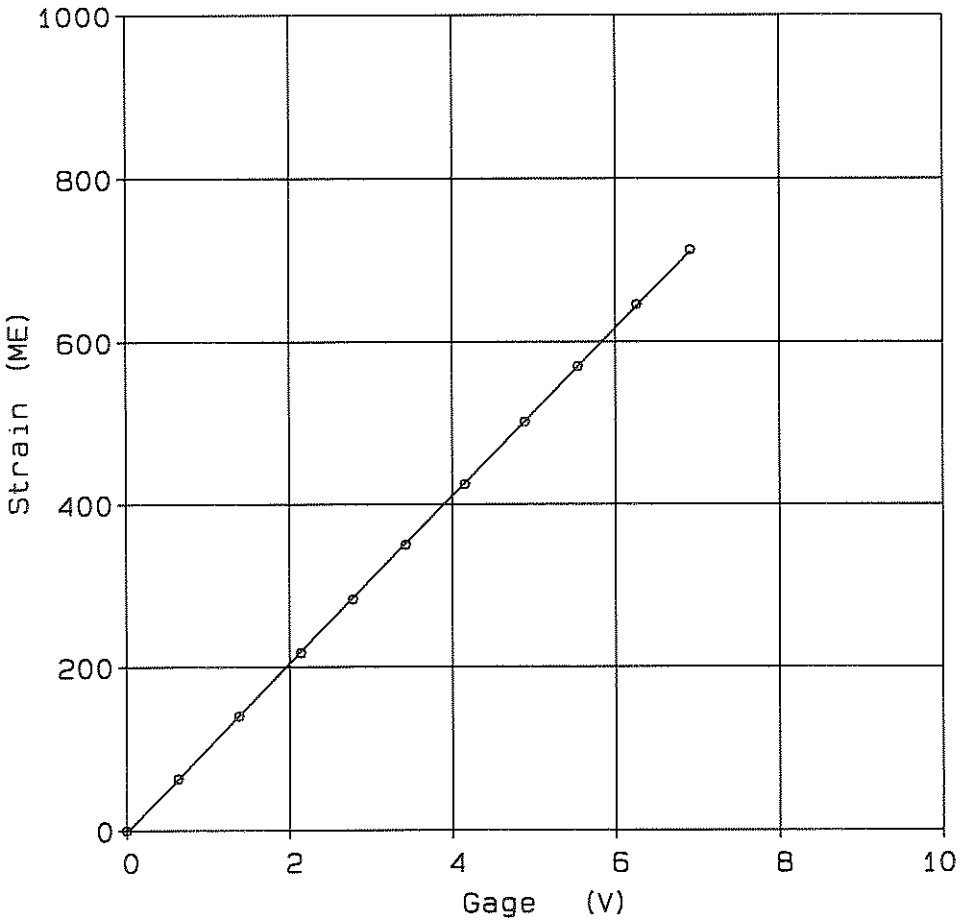

PDA Cal Factor	=	103.3 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	358.6 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
65	.64
140	1.38
218	2.14
284	2.78
351	3.43
426	4.16
503	4.90
570	5.55
646	6.27
714	6.92

Calibrated by: James M Gabr

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2