Pile Dynamics, Inc.

Transducer 281W

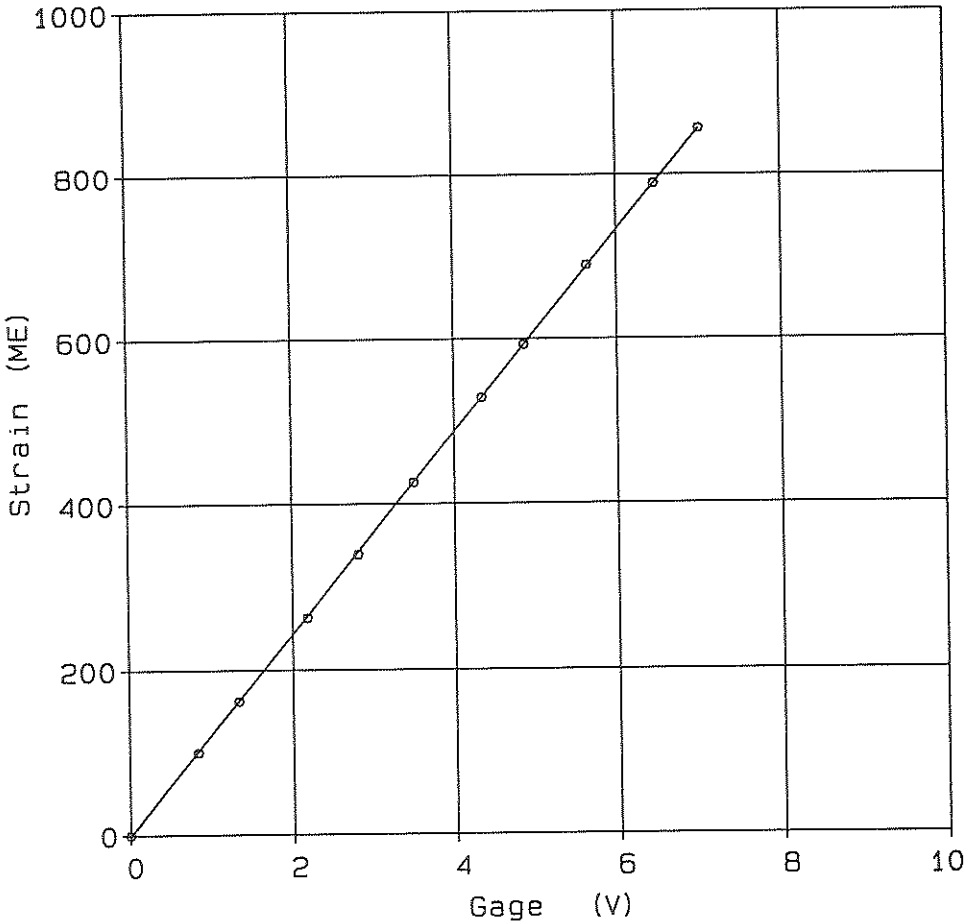

PDA Cal Factor = 122.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 425.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
101	.84
162	1.34
263	2.18
340	2.81
427	3.51
530	4.35
594	4.86
690	5.65
790	6.46
857	7.01

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 12-Jan-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2