Pile Dynamics Inc
Transducer 282I

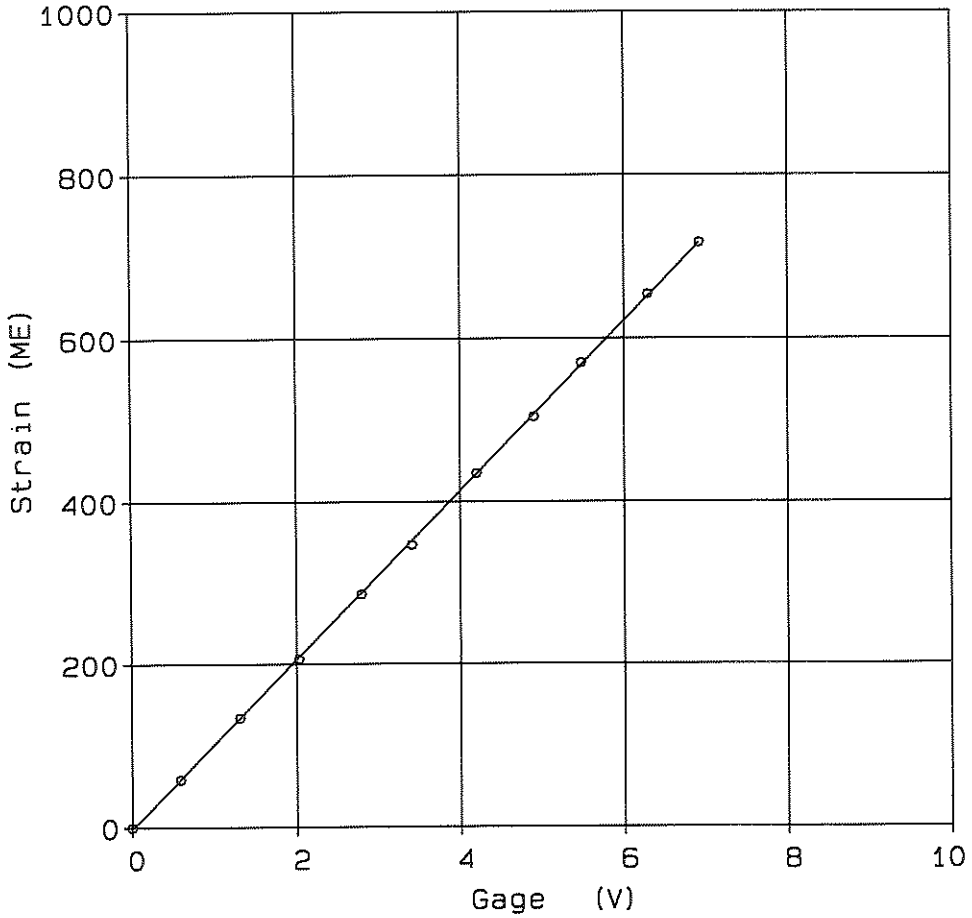

PDA Cal Factor = 104.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 360.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
59	.59
134	1.32
206	2.03
286	2.79
348	3.41
435	4.21
505	4.91
570	5.49
654	6.30
717	6.93

Calibrated by: _____

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2