Pile Dynamics, Inc.

Transducer 282W

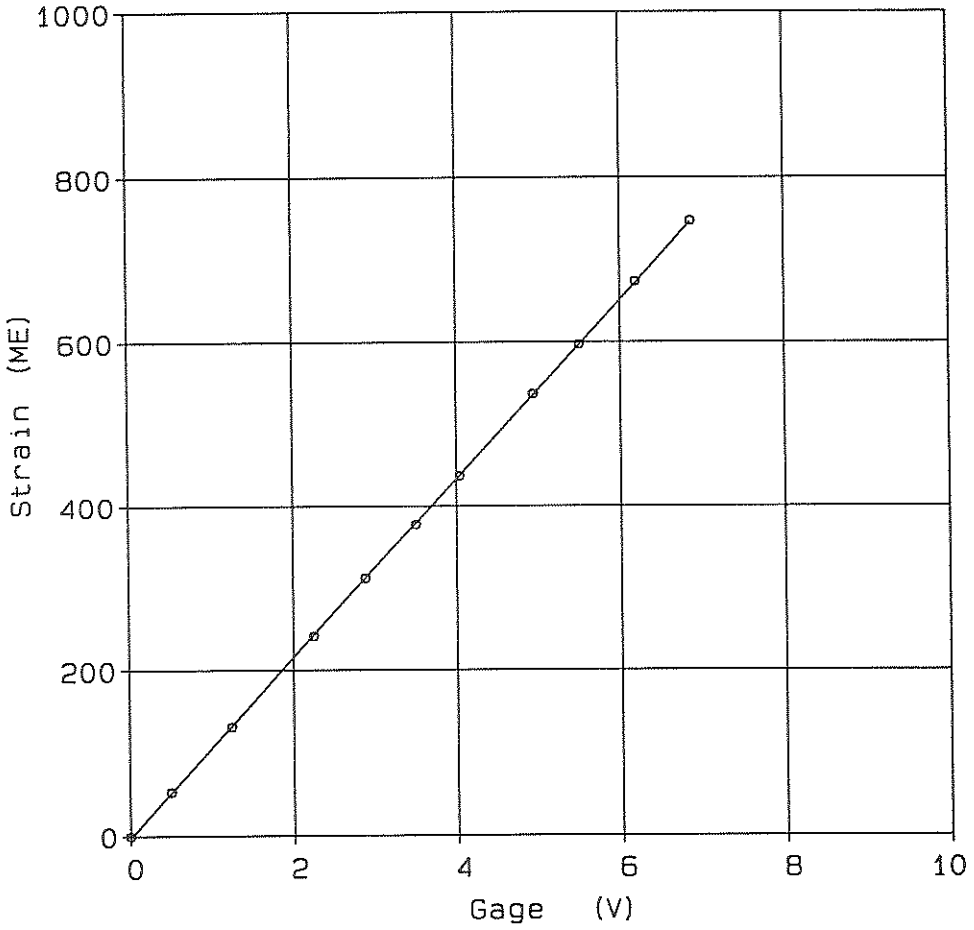

PDA Cal Factor	=	109.0 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	378.4 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
53	.51
133	1.24
242	2.26
312	2.89
378	3.50
438	4.04
538	4.95
598	5.50
674	6.20
747	6.87

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 12-Jan-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2