Pile Dynamics Inc
Transducer 283I

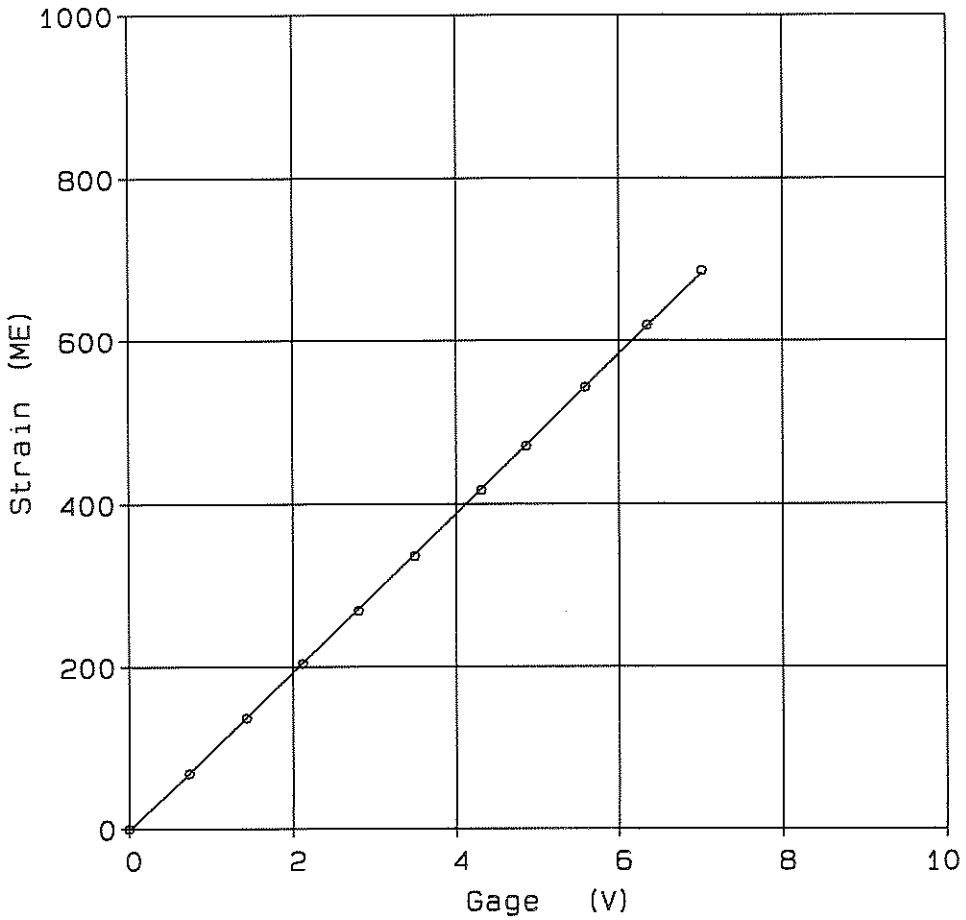

PDA Cal Factor	=	97.7 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	339.4 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.73
137	1.44
204	2.13
269	2.80
337	3.49
418	4.31
472	4.87
544	5.60
620	6.35
686	7.03

Calibrated by: _____

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2