Pile Dynamics, Inc.

Transducer 283W

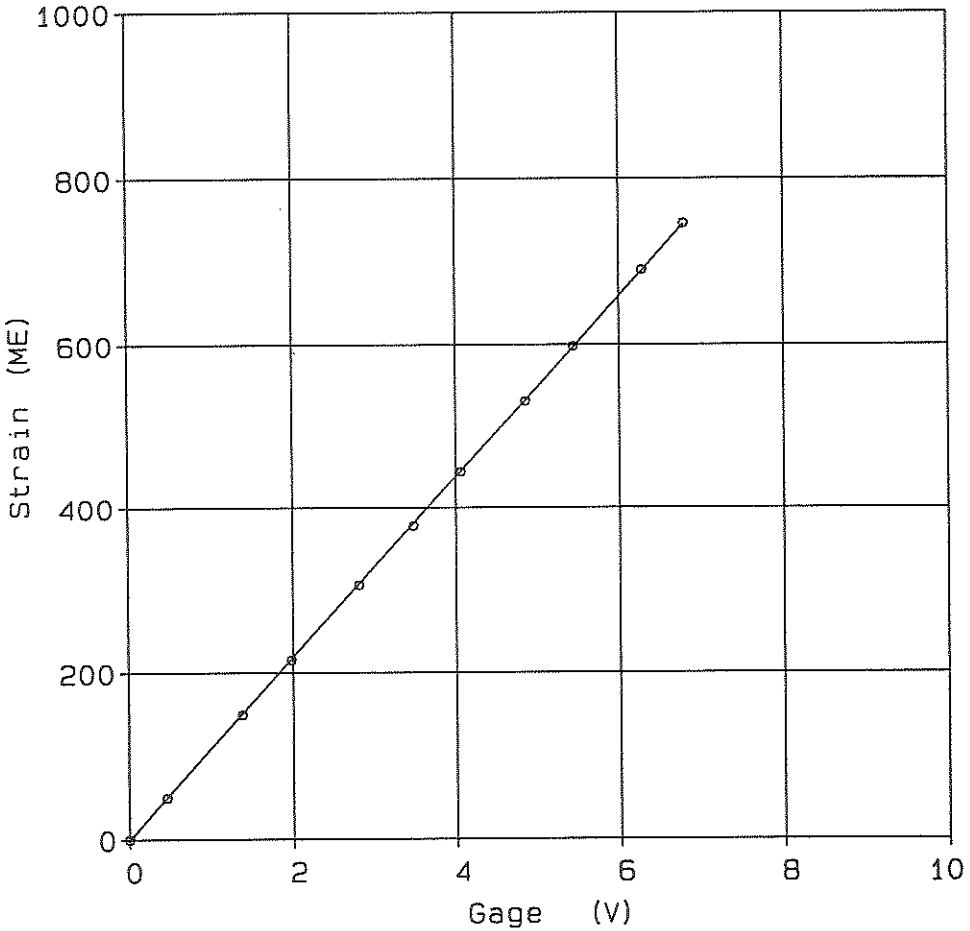

PDA Cal Factor = 110.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 381.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
50	.46
150	1.38
215	1.99
307	2.82
379	3.49
445	4.07
531	4.86
598	5.45
690	6.29
746	6.80

Calibrated by: _____

Calibrated on: 12-Jan-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2