Pile Dynamics Inc
Transducer 284I

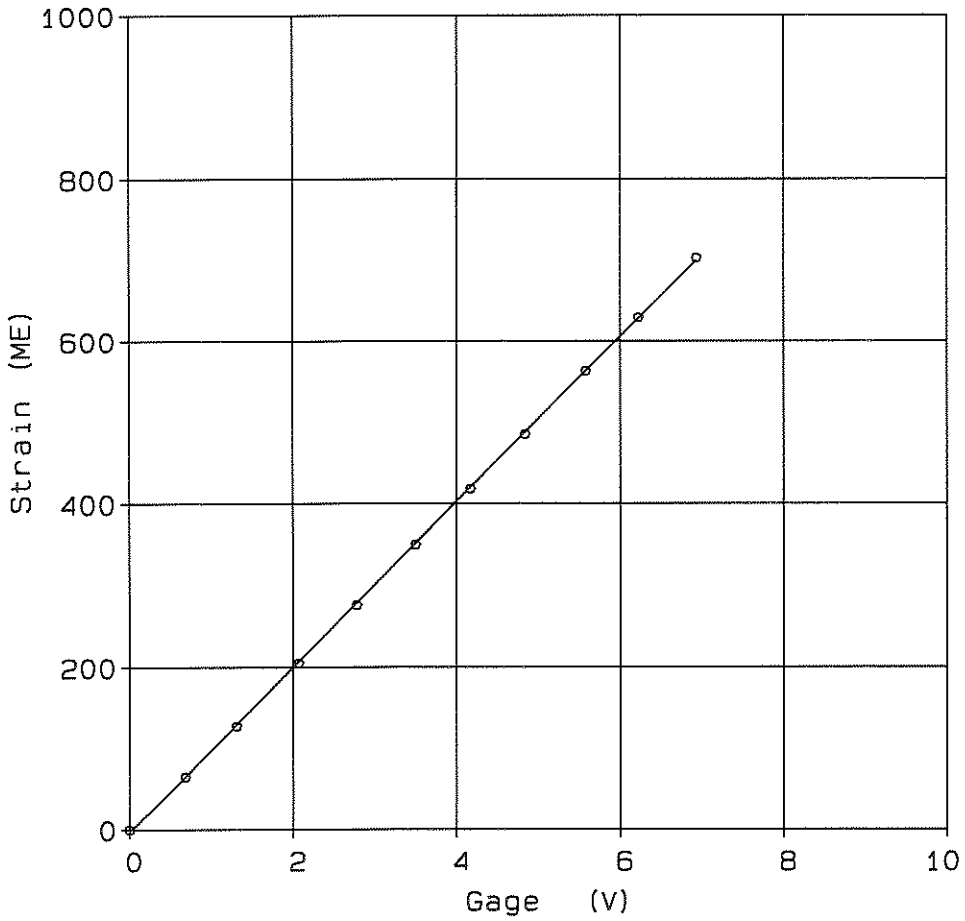

PDA Cal Factor = 101.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 352.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.68
129	1.31
205	2.07
276	2.79
350	3.50
418	4.17
486	4.84
564	5.58
629	6.22
704	6.94

Calibrated by: James M Goble

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2