Pile Dynamics Inc
Transducer 285I

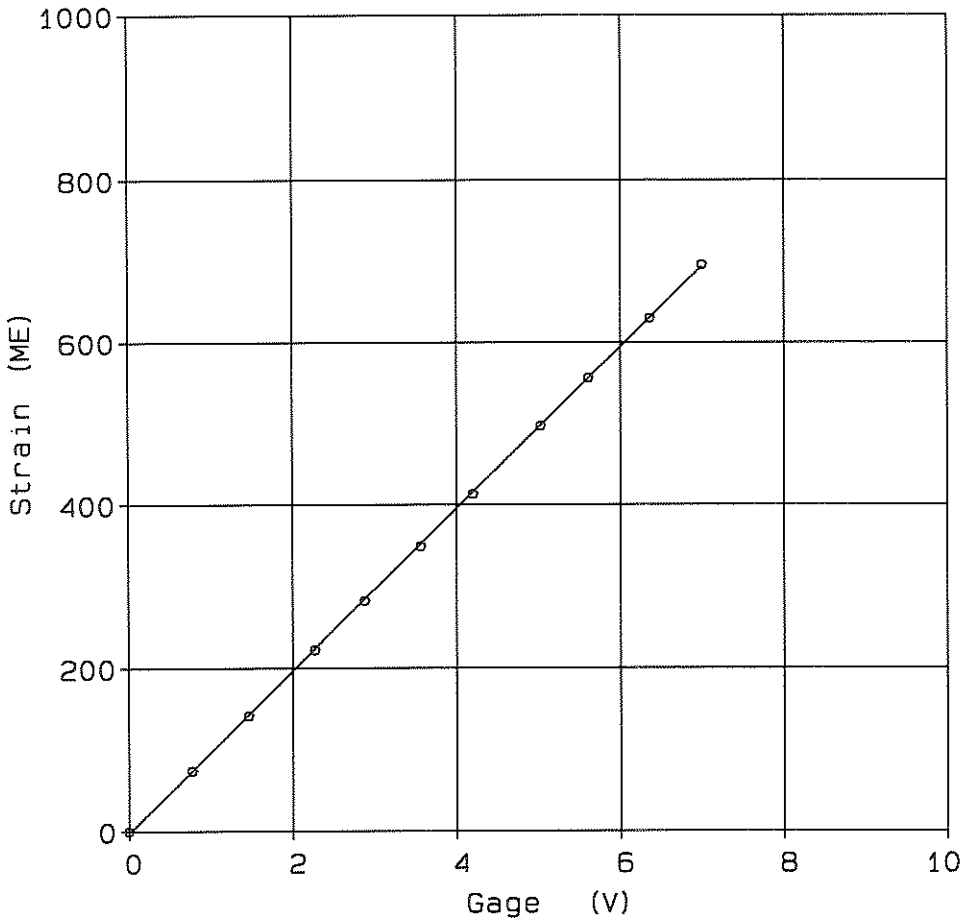

PDA Cal Factor = 99.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 345.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.77
142	1.46
222	2.28
282	2.88
350	3.56
413	4.20
497	5.03
556	5.62
631	6.36
697	7.01

Calibrated by: Jan M Bek

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2