Pile Dynamics, Inc.
Transducer 285W

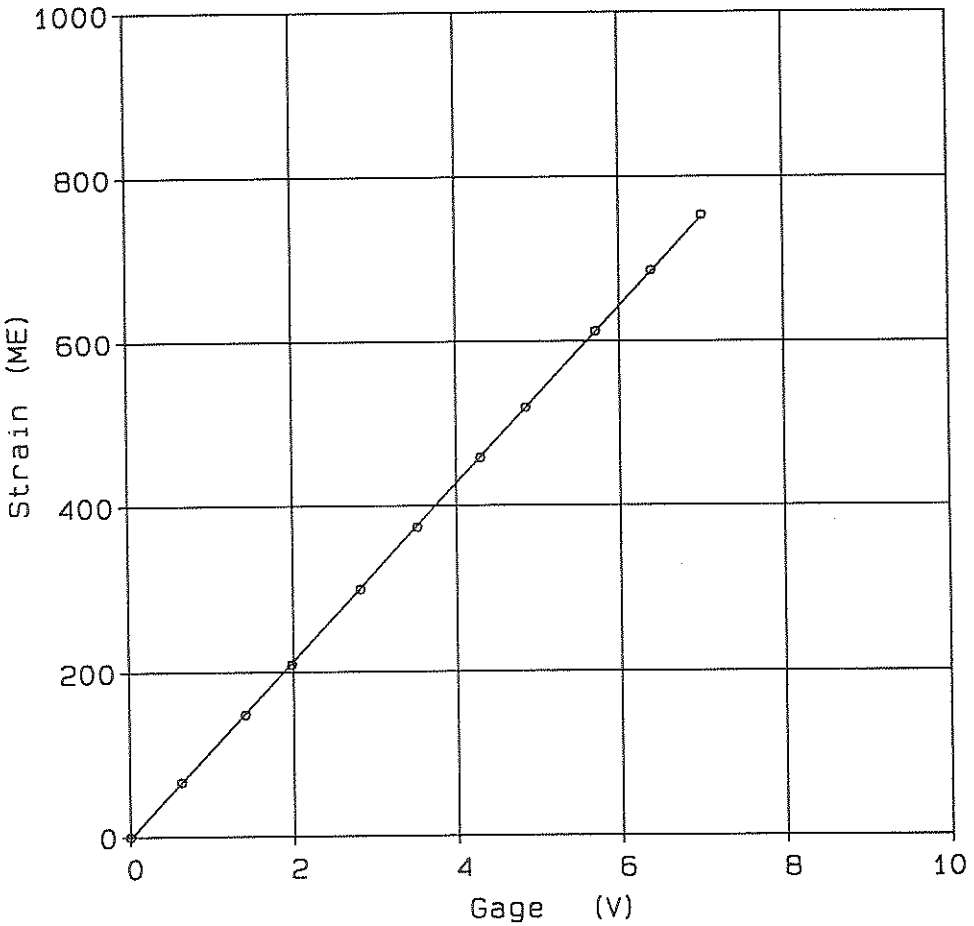

PDA Cal Factor = 107.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 373.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.63
149	1.41
210	1.98
301	2.82
375	3.52
458	4.29
519	4.86
613	5.71
686	6.39
753	7.01

Calibrated by: J. Denkelhoff

Calibrated on: 12-Jan-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2