Pile Dynamics Inc
Transducer 286I

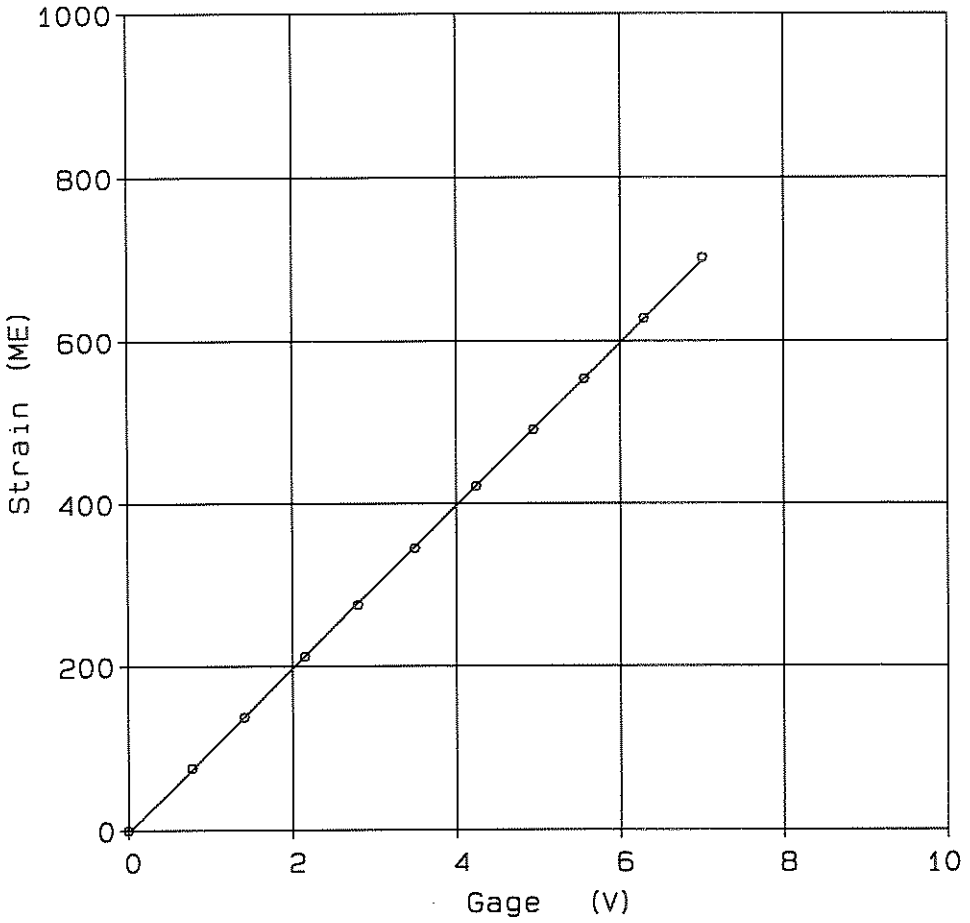

PDA Cal Factor = 100.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 348.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.78
138	1.41
212	2.16
276	2.80
345	3.49
421	4.25
491	4.94
555	5.57
629	6.29
703	7.01

Calibrated by: Jan M Bek

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2