Pile Dynamics Inc
Transducer 286,W

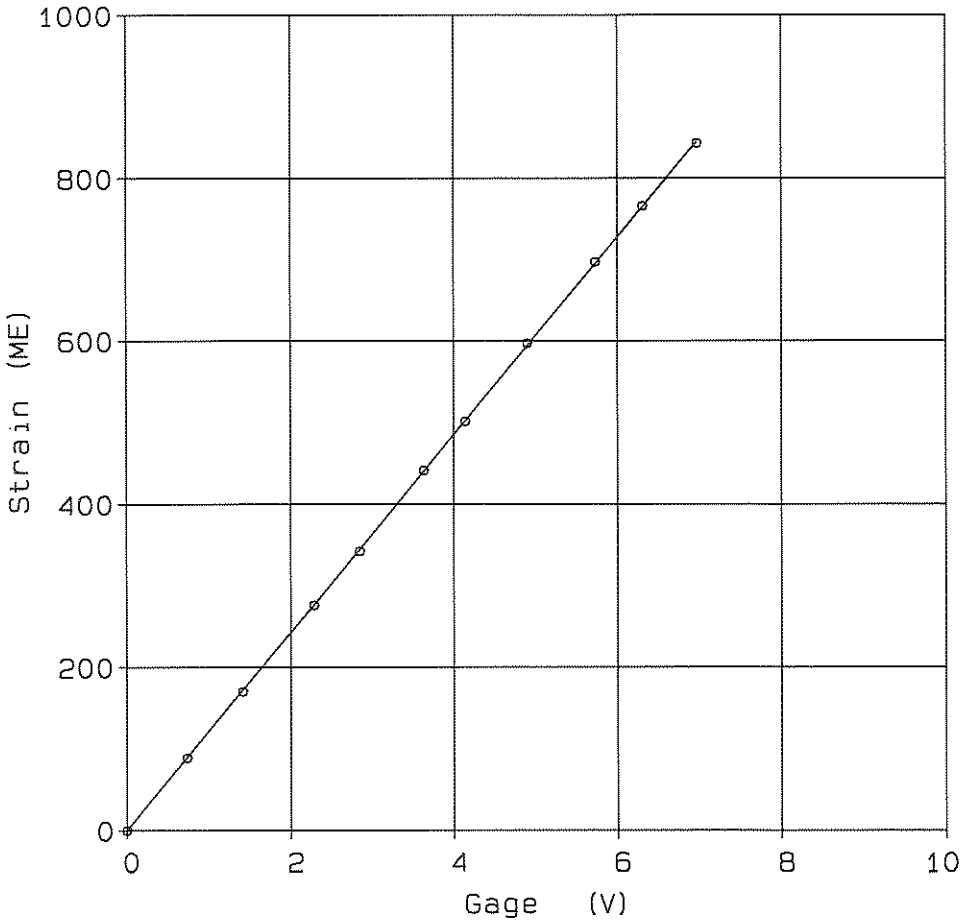

PDA Cal Factor = 121.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 421.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
90	.74
171	1.42
276	2.28
343	2.85
441	3.63
502	4.15
597	4.91
698	5.74
766	6.32
844	6.97

Calibrated by: J. Pentadeff

Calibrated on: 13-Aug-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2