Pile Dynamics Inc
Transducer 287I

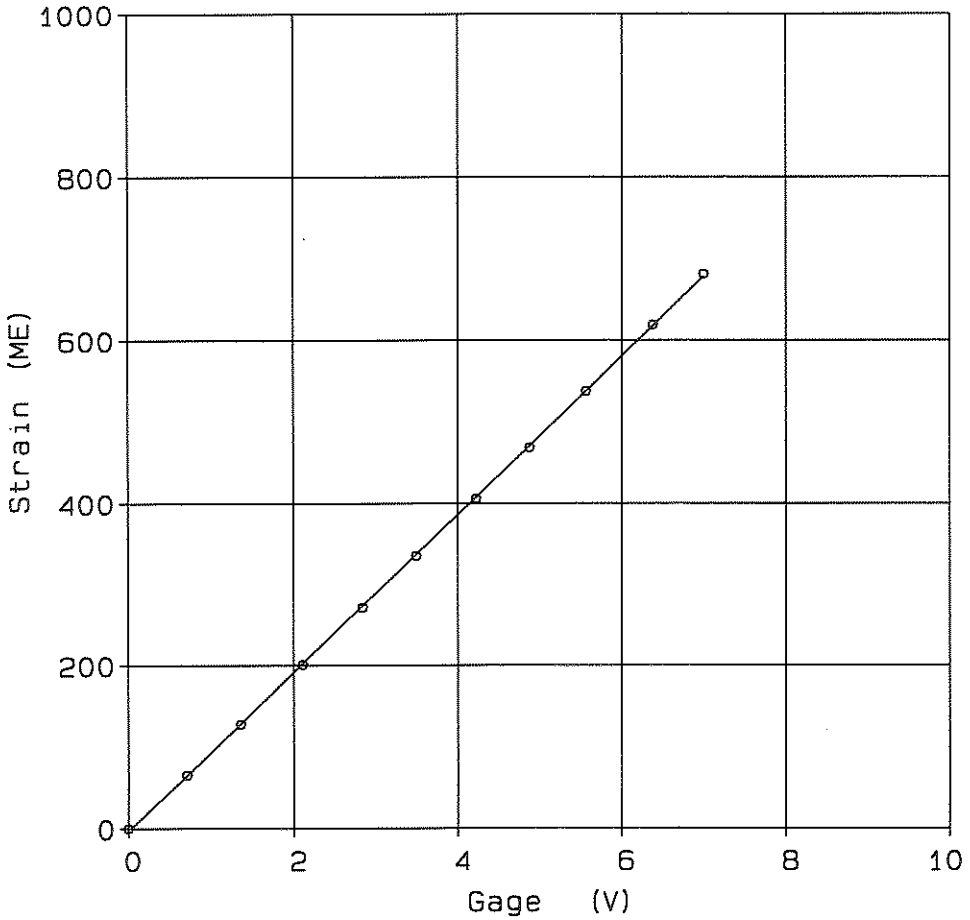

PDA Cal Factor	=	97.3 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	337.7 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.70
129	1.36
202	2.12
272	2.84
335	3.50
407	4.23
470	4.88
538	5.57
619	6.38
681	7.01

Calibrated by: _____

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2