Pile Dynamics Inc

Transducer 287W

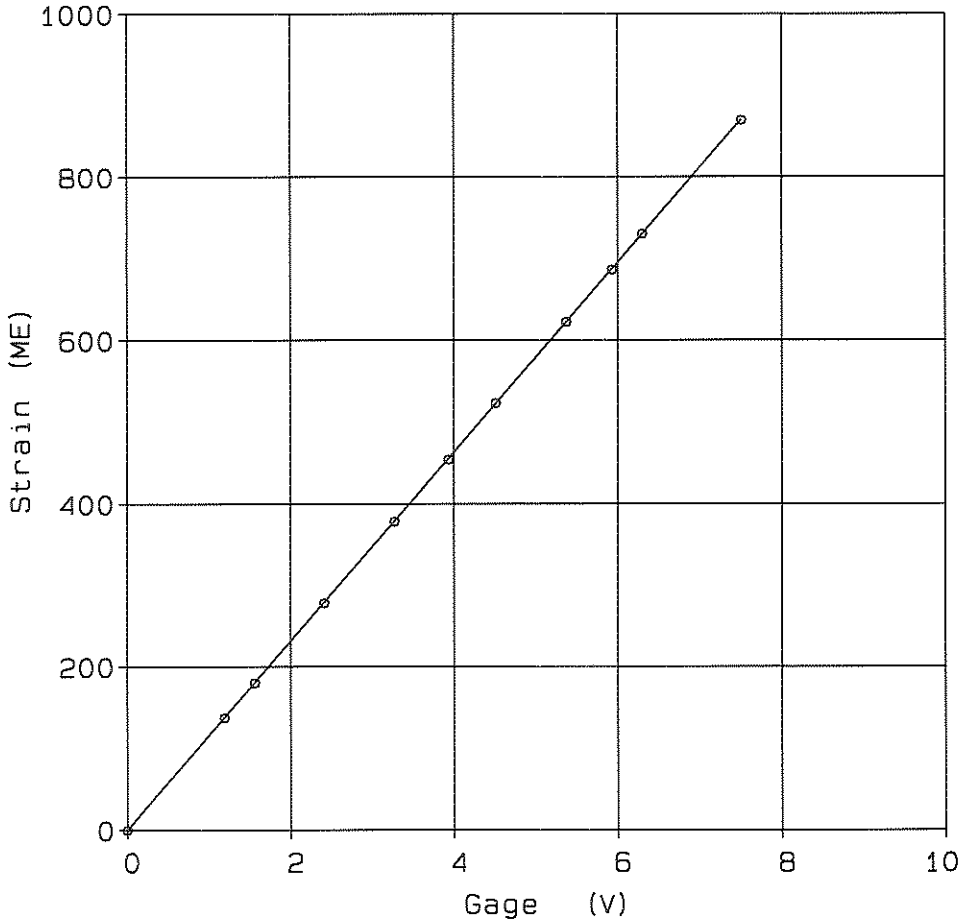

PDA Cal Factor = 115.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 402.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
138	1.20
180	1.57
279	2.42
379	3.28
455	3.93
523	4.52
623	5.38
687	5.94
730	6.31
870	7.52

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 03-Jul-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2