Pile Dynamics Inc
Transducer 288I

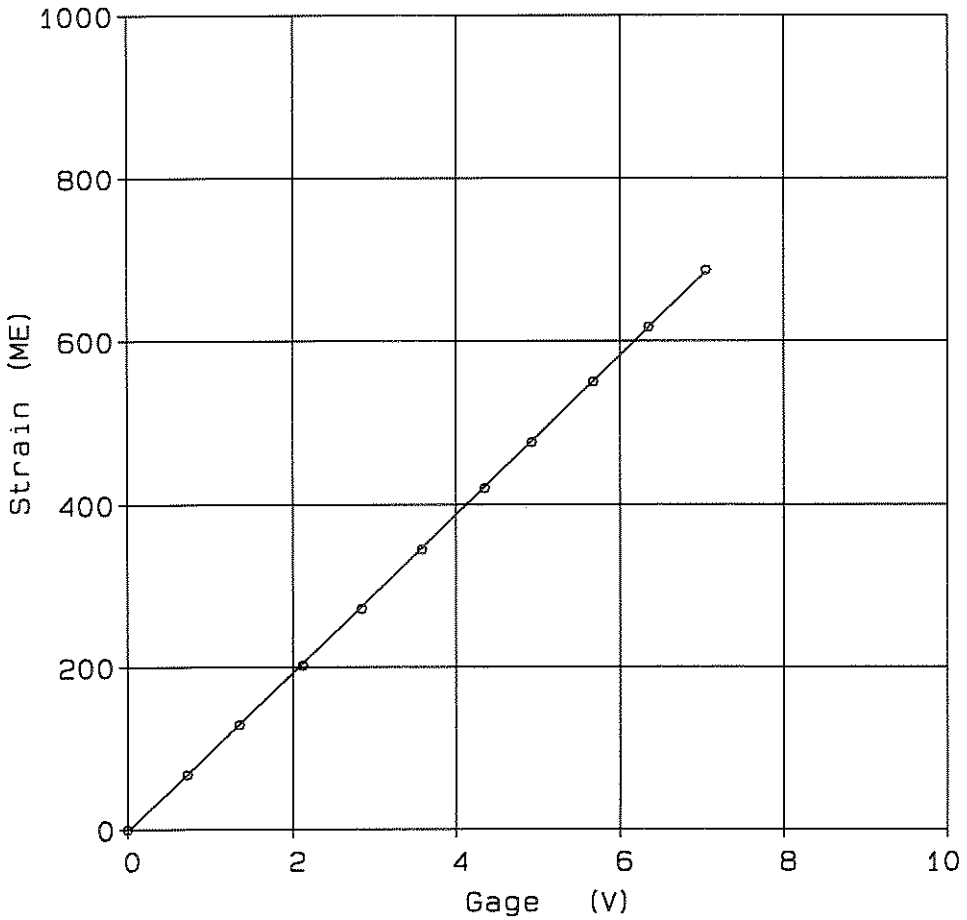

PDA Cal Factor = 97.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 338.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
69	.72
129	1.36
203	2.12
272	2.84
345	3.59
421	4.36
477	4.93
551	5.68
618	6.35
688	7.06

Calibrated by: _____

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2