Pile Dynamics, Inc.
Transducer 288,W

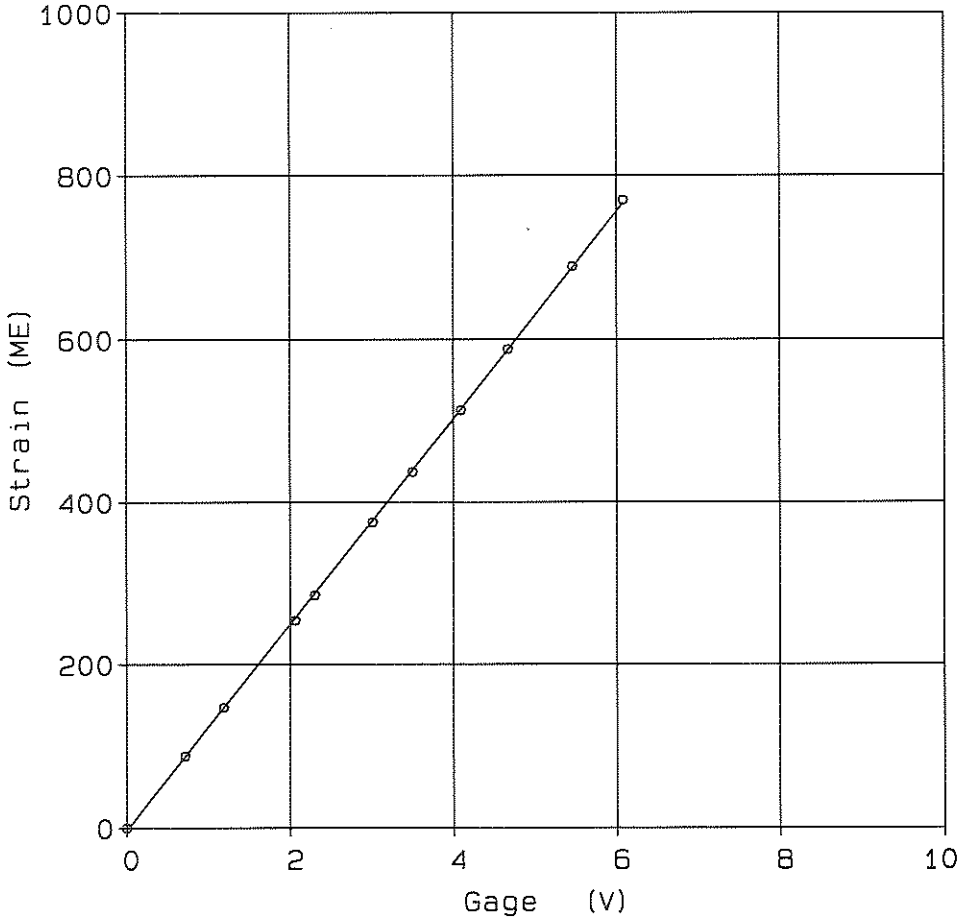

PDA Cal Factor = 126.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 439.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
89	.72
147	1.19
254	2.06
285	2.30
375	3.02
437	3.50
514	4.09
588	4.68
689	5.47
771	6.09

Calibrated by: J. Deutschlaf

Calibrated on: 27-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2