Pile Dynamics Inc
Transducer 289I

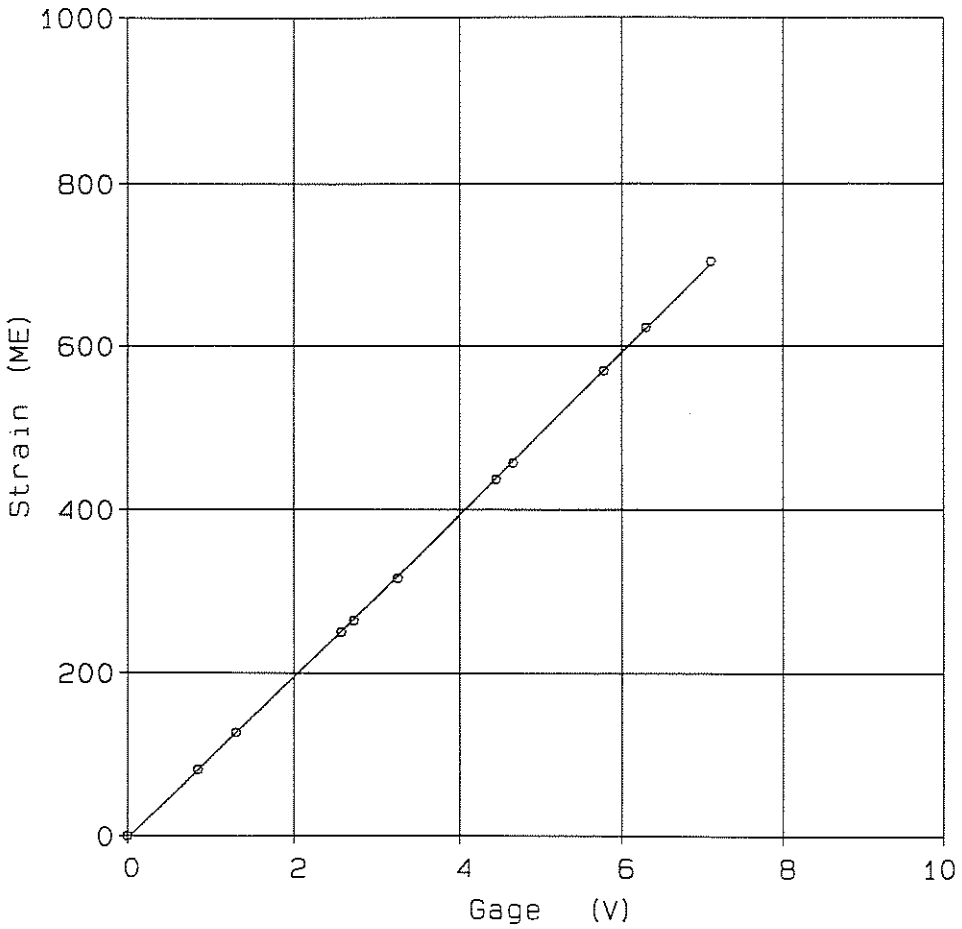

PDA Cal Factor = 99.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 344.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
83	.85
127	1.32
251	2.57
264	2.71
317	3.25
438	4.45
458	4.66
571	5.78
624	6.31
705	7.11

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 17-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2