Pile Dynamics, Inc.
Transducer 289W

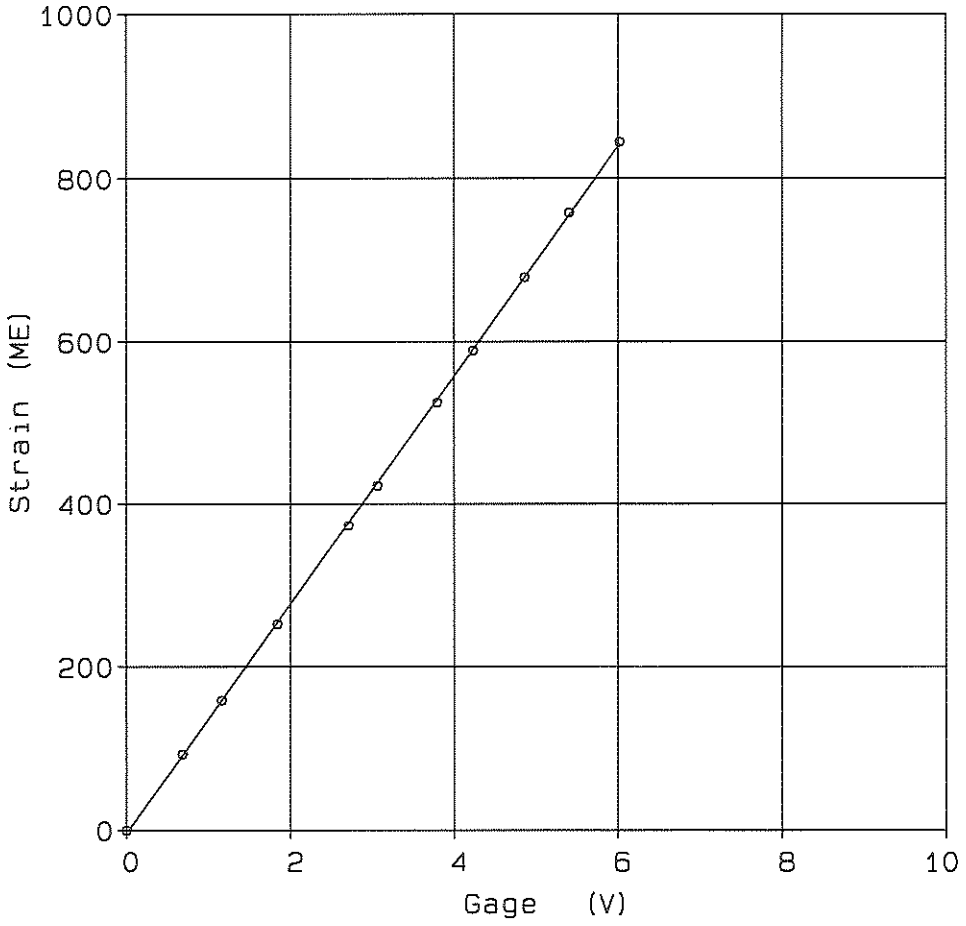

PDA Cal Factor = 140.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 487.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
93	.68
160	1.17
253	1.85
374	2.71
423	3.06
526	3.79
589	4.24
680	4.87
759	5.40
844	6.03

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 27-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2