# Pile Dynamics Inc
# Transducer 290I

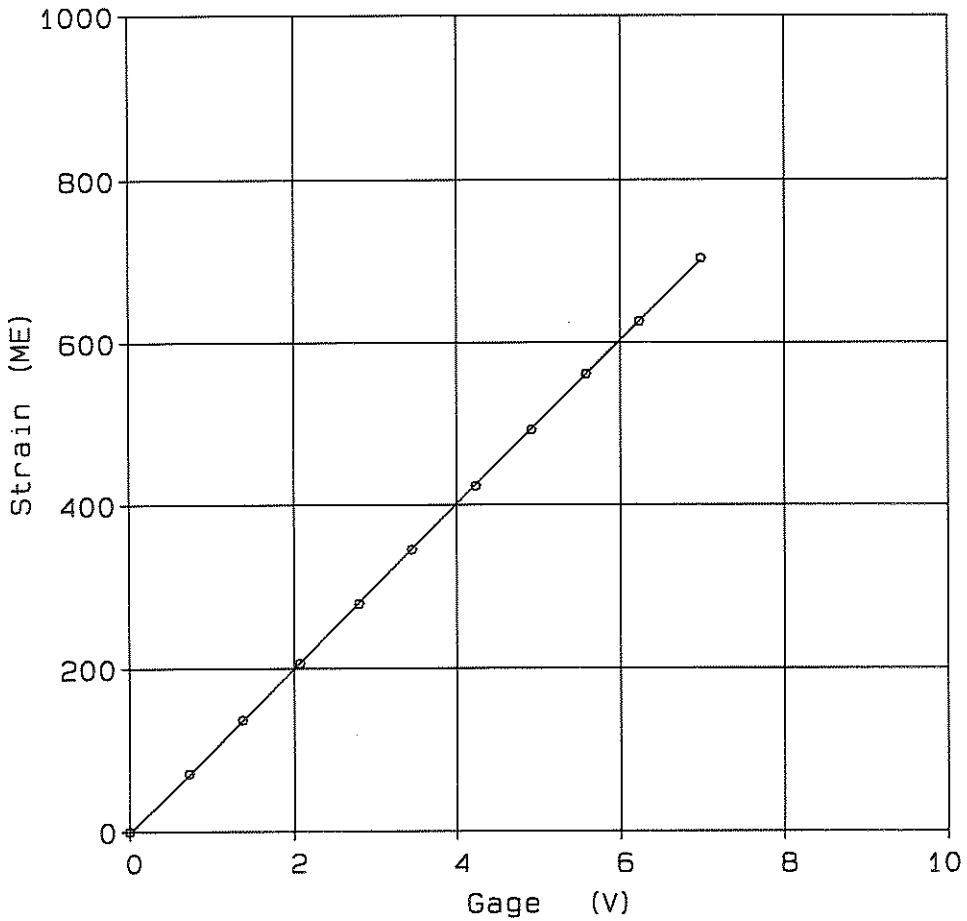


PDA Cal Factor = 100.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 350.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 72 | .73 |
| 137 | 1.38 |
| 207 | 2.08 |
| 279 | 2.80 |
| 345 | 3.46 |
| 424 | 4.24 |
| 493 | 4.91 |
| 562 | 5.59 |
| 627 | 6.23 |
| 704 | 6.98 |

Calibrated by: James M Gabr

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2