Pile Dynamics, Inc.
Transducer 290W

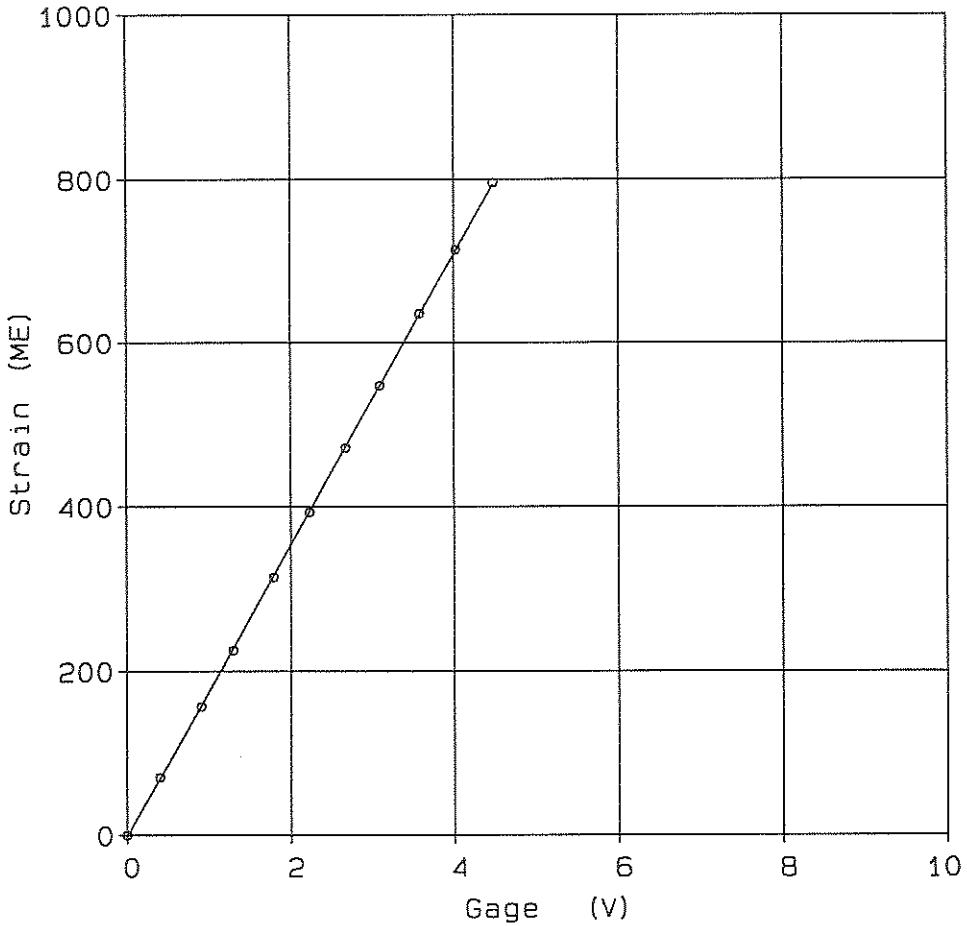

PDA Cal Factor = 177.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 617.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
71	.41
158	.91
226	1.29
314	1.79
393	2.24
471	2.67
547	3.09
635	3.58
715	4.03
796	4.48

Calibrated by: J. Davidoff

Calibrated on: 04-11-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2