Pile Dynamics Inc
Transducer 291I

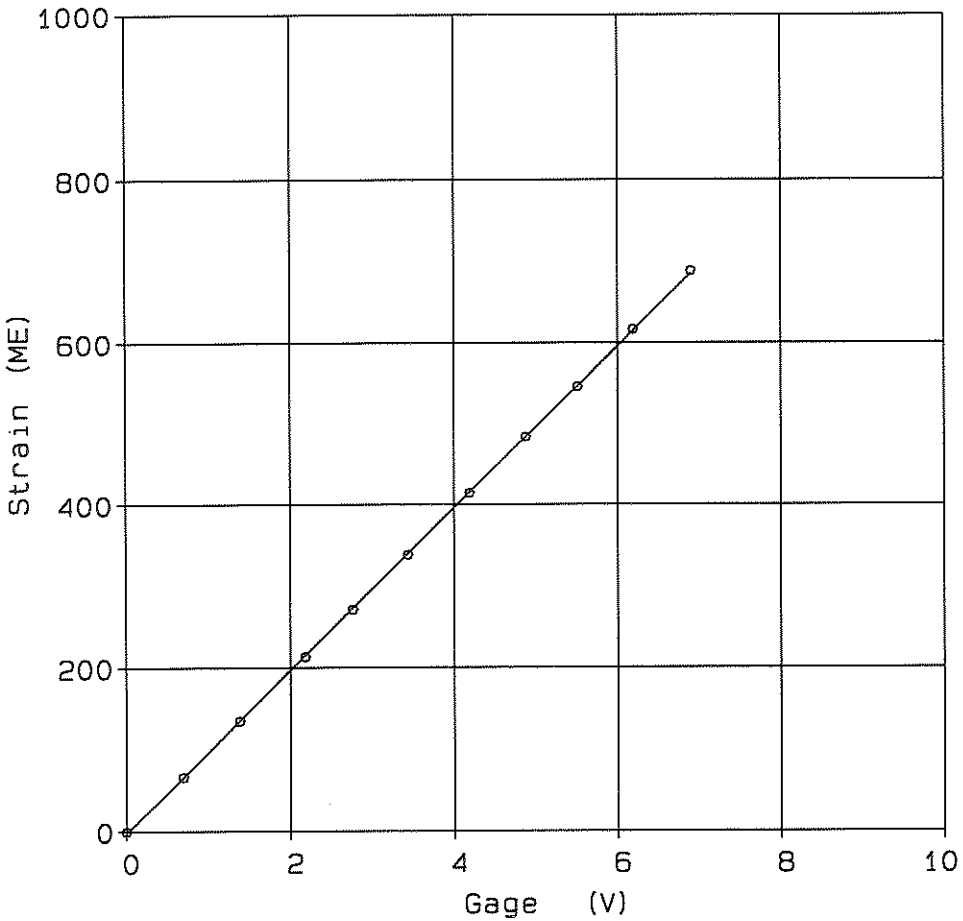

PDA Cal Factor = 99.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 346.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.70
135	1.38
214	2.18
272	2.77
339	3.44
414	4.19
484	4.89
547	5.51
617	6.20
688	6.90

Calibrated by: [signature]

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2