Pile Dynamics Inc

Transducer 291W

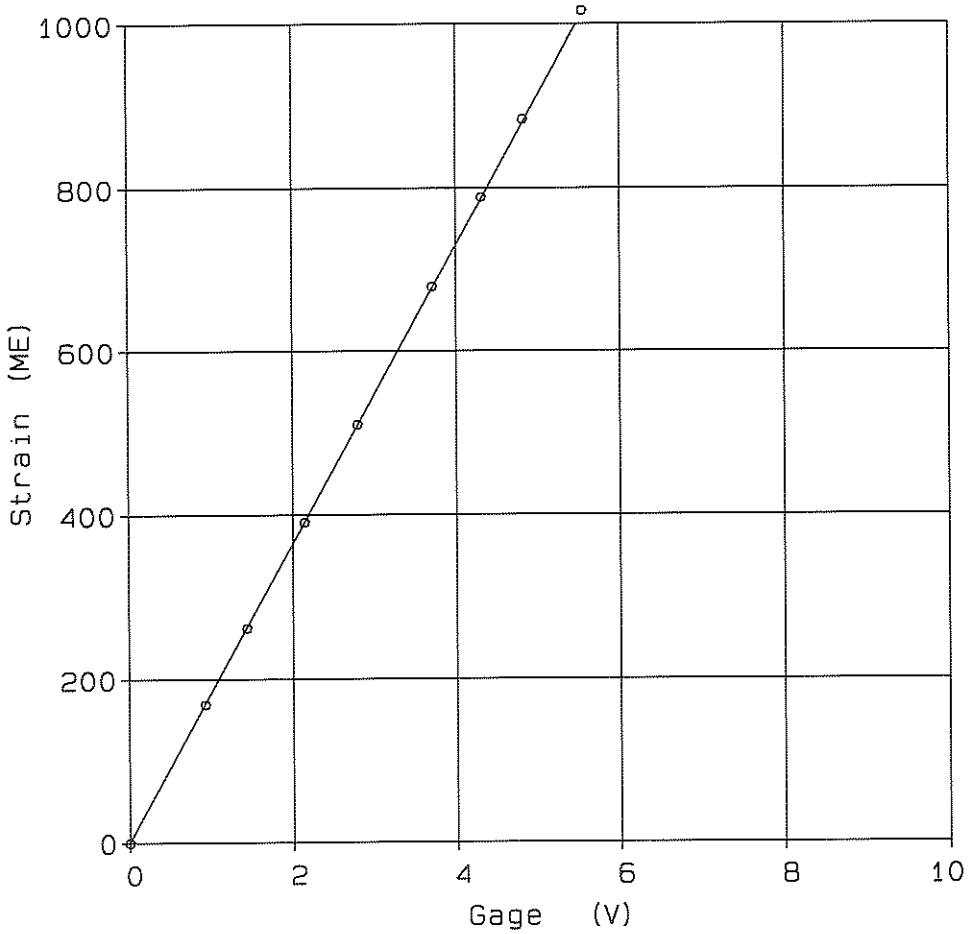

PDA Cal Factor = 182.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 632.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
169	.93
262	1.44
391	2.15
511	2.79
680	3.71
790	4.31
884	4.83
1016	5.55
1121	6.14
1279	7.06

Calibrated by: J. Rentschler

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2