Pile Dynamics Inc
Transducer 292I

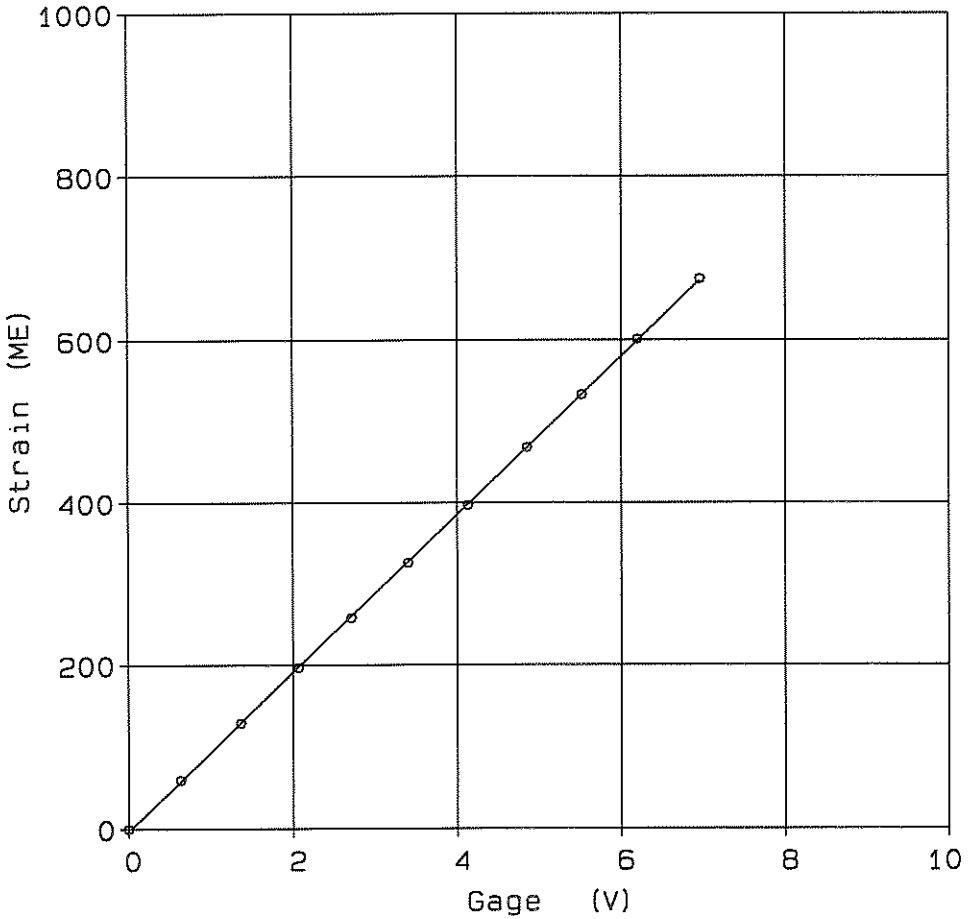

PDA Cal Factor = 97.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 337.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
60	.64
130	1.37
197	2.07
259	2.71
326	3.41
398	4.14
468	4.86
534	5.53
601	6.21
676	6.96

Calibrated by: James M Osborn

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2