Pile Dynamics Inc
Transducer 293I

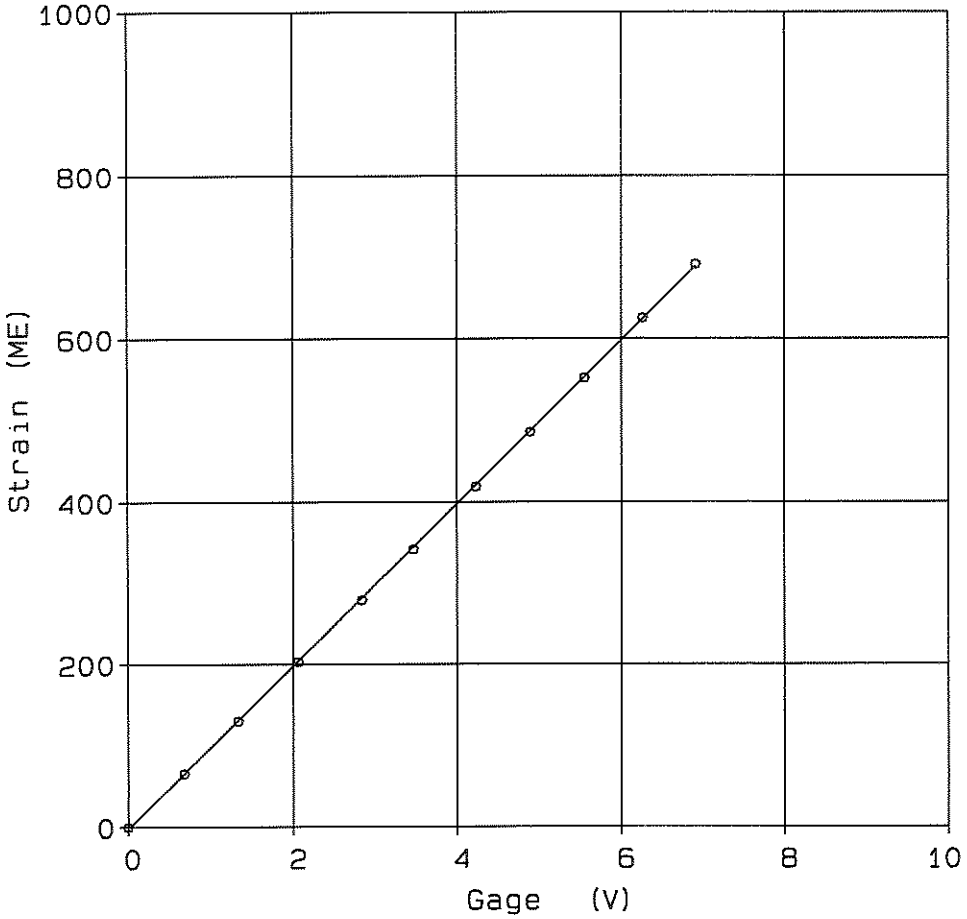

PDA Cal Factor = 100.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 347.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.68
130	1.33
203	2.07
280	2.84
343	3.47
420	4.23
486	4.89
552	5.55
626	6.27
692	6.92

Calibrated by: _____

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2