Pile Dynamics Inc
Transducer 293W

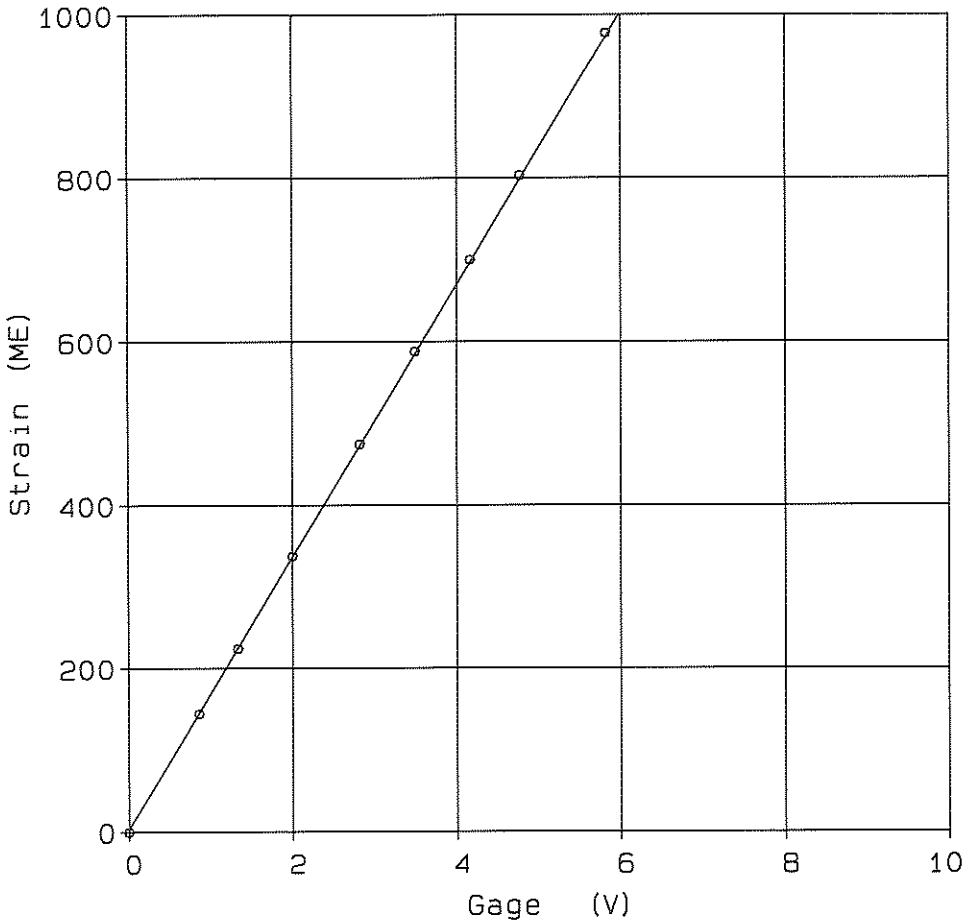

PDA Cal Factor	=	166.6 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	578.6 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
144	.86
224	1.33
338	2.01
475	2.82
589	3.50
700	4.16
804	4.78
978	5.83
1102	6.59
1168	7.06

Calibrated by: J. Rentschler

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2